精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ブラザー	バーコード	P5185
型式	TC-31A		

精度評価		コメント
A	0～0.02㎜	
B	0～0.03㎜	
C	0～0.04㎜	
D	0～0.05㎜	

振り回し(300ピッチ)

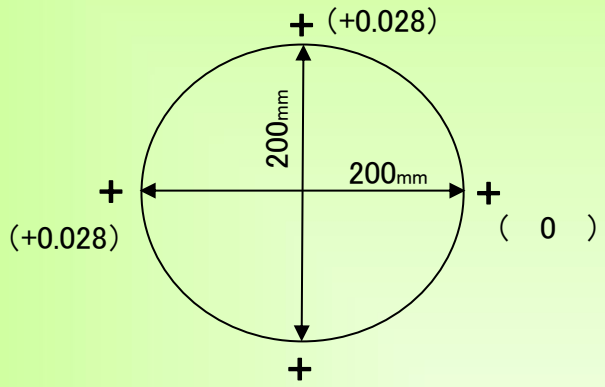

主軸振れ

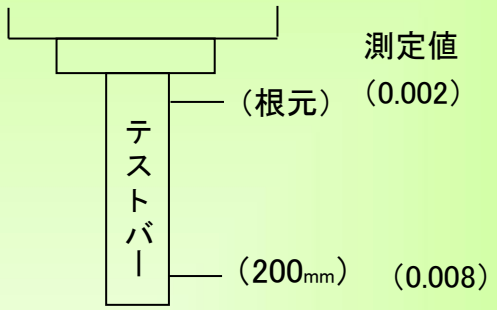

直角度

【Y Z】測定値 (0.016)

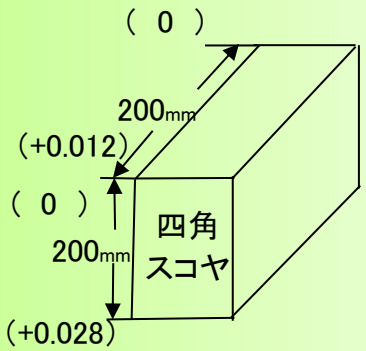

【X Z】測定値 (0.018)

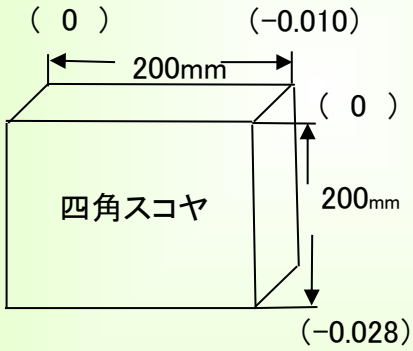

【X Y】測定値 (0.010)

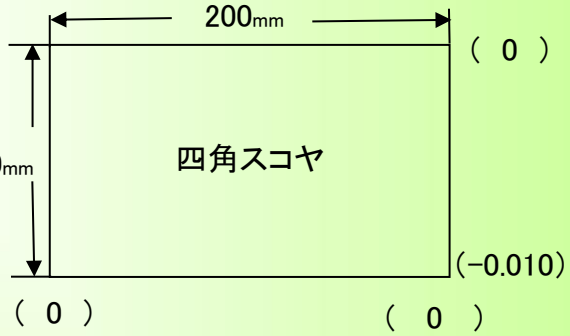

上面精度

バックラッシュ X軸→0.002 Y軸→0.002 Z軸→0.002

※テーブルサイズ 500×270
( )→パレット1 [ ]→パレット2
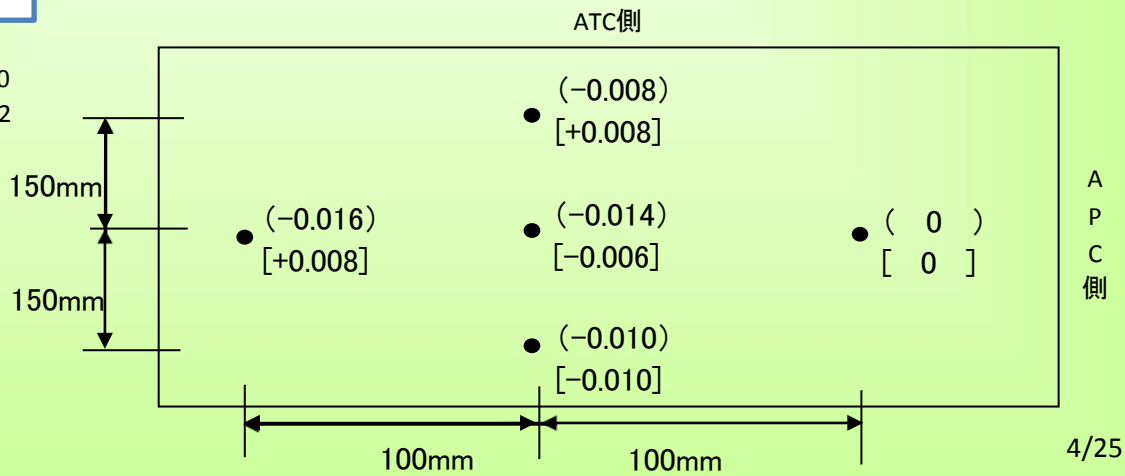
テーブル上面の平行度		
500以下	0.020	○
500を超え800以下	0.025	
800を超え1250以下	0.030	
1250を超え2000以下	0.040