精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	牧野フライス	ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ	P5620
型式	V22		

精度評価		コメント
Ⓐ	0～0.02㎜	精度良好です
B	0～0.03㎜	
C	0～0.04㎜	
D	0～0.05㎜	

振り回し(300ピッチ)

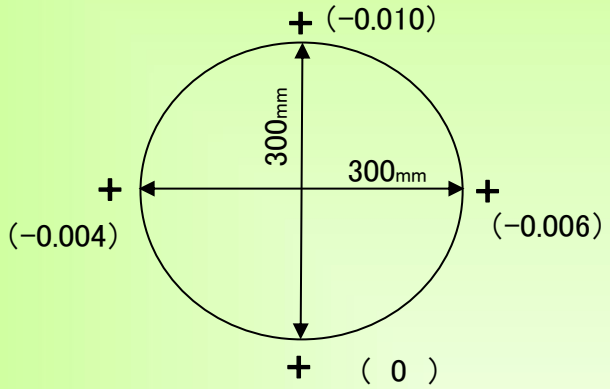

主軸振れ

※テストバーが無いため測定不可

直角度

【Y Z】測定値 (0.004)　【X Z】測定値 (0.006)　【X Y】測定値 (0.002)

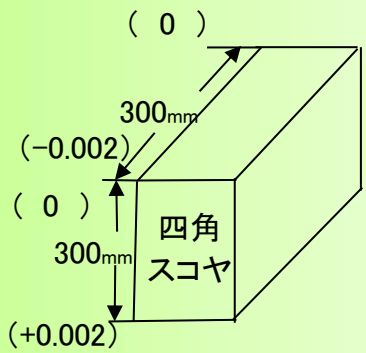

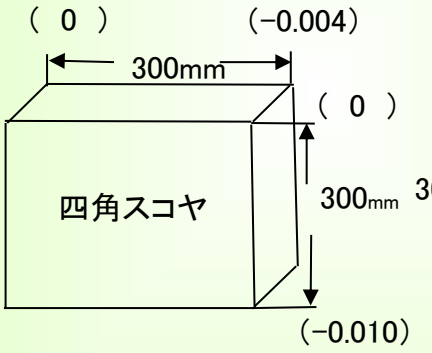

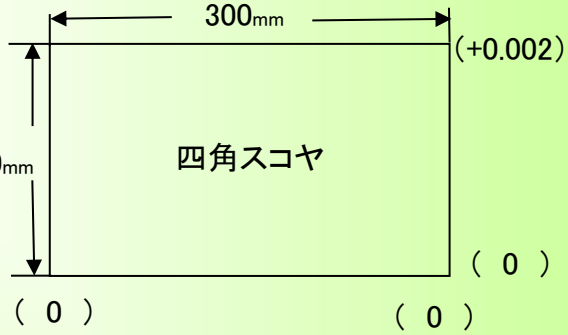

上面精度

※テーブルサイズ　450×350
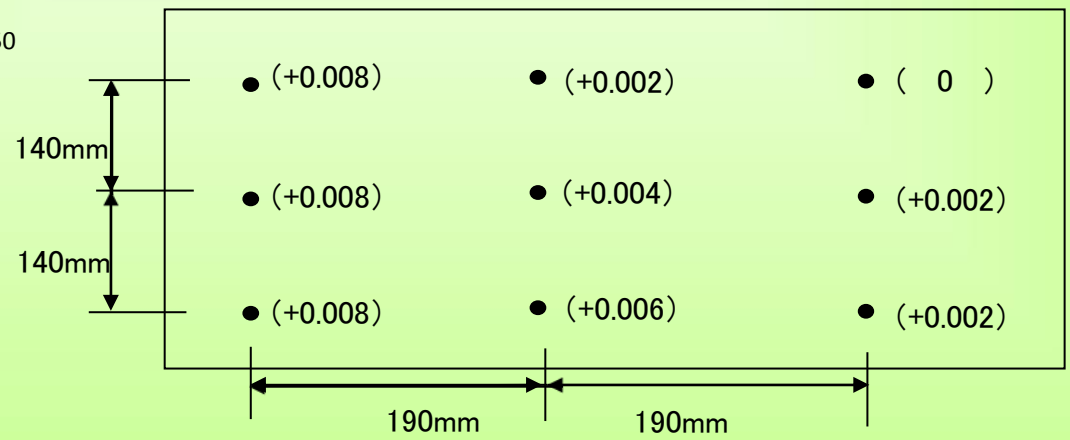
テーブル上面の平行度		
500以下	0.020	○
500を超え800以下	0.025	
800を超え1250以下	0.030	
1250を超え2000以下	0.040