


精度測定検査表

Examination for precision list


| | | | |
|------|----------|-------|-------|
| メーカー | ヤマザキマザック | バーコード | P5607 |
| 型式 | VCN-410B | | |

| 精度評価 | | コメント |
|------|------------|--------|
| Ⓐ | 0 ~ 0.02mm | 精度良好です |
| B | 0 ~ 0.03mm | |
| C | 0 ~ 0.04mm | |
| D | 0 ~ 0.05mm | |

振り回し(300ピッチ)

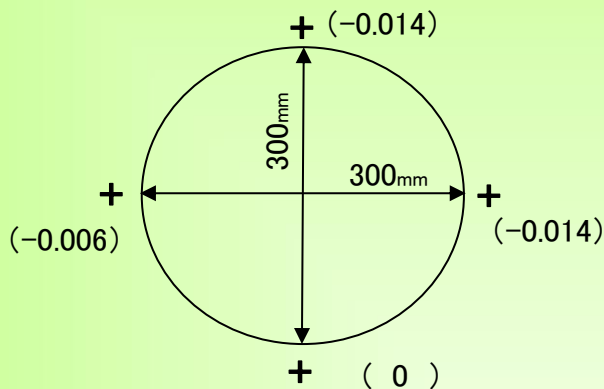

主軸振れ



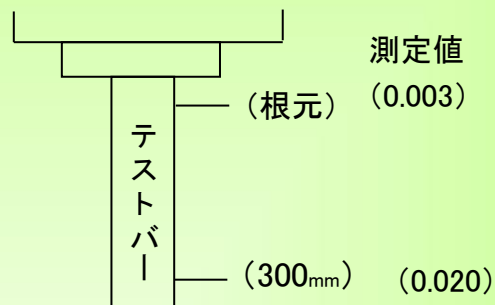


直角度

【Y Z】測定値 (0.016)

【X Z】測定値 (0.006)


【X Y】測定値 (0.010)

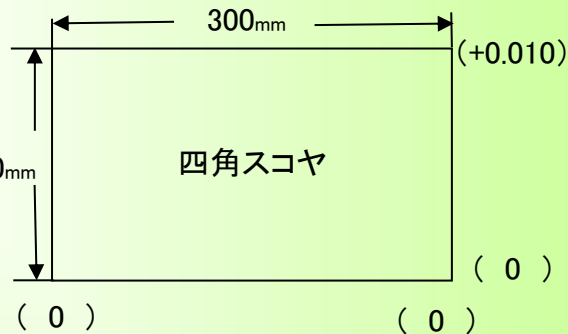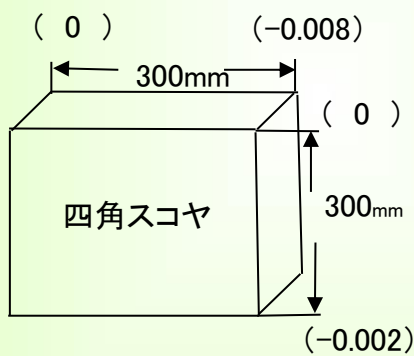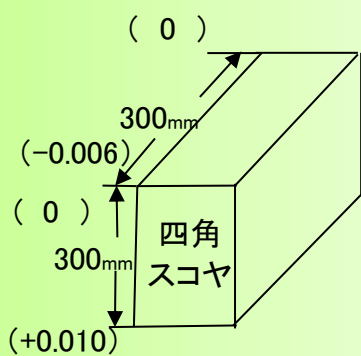

上面精度

※テーブルサイズ 1100×410

| テーブル上面の平行度 | |
|---------------|-------|
| 500以下 | 0.020 |
| 500を超え800以下 | 0.025 |
| 800を超え1250以下 | 0.030 |
| 1250を超え2000以下 | 0.040 |

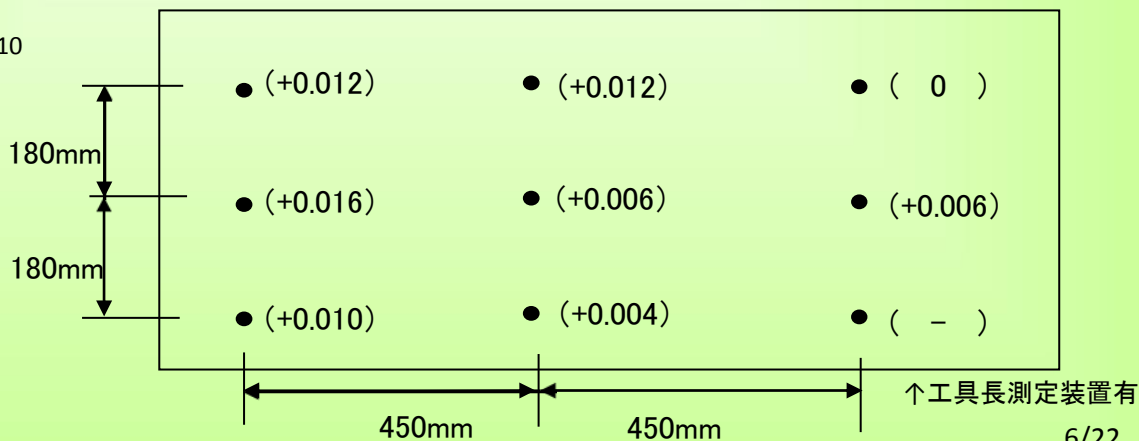

↑工具長測定装置有

6/22