精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2004年製	バーコード	P007135
型式	MB-46VAE	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

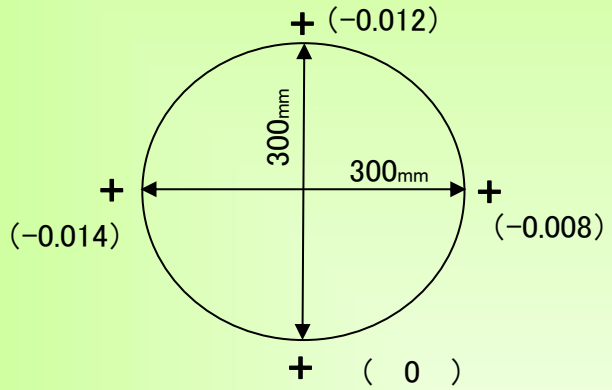

主軸振れ

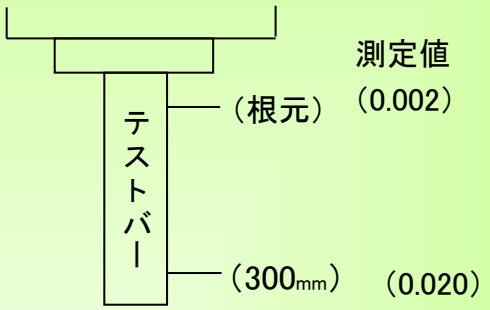

直角度

【YZ】測定値 (0.020)　【XZ】測定値 (0.020)　【X Y】測定値 (0.010)

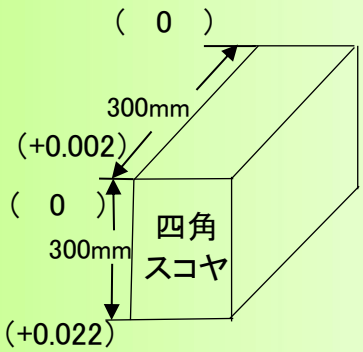

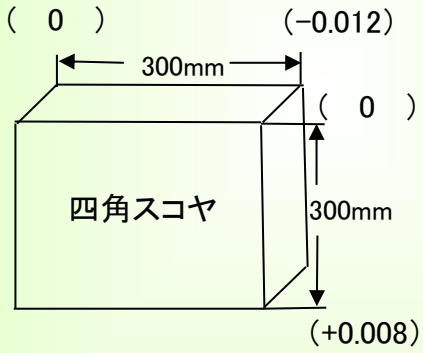

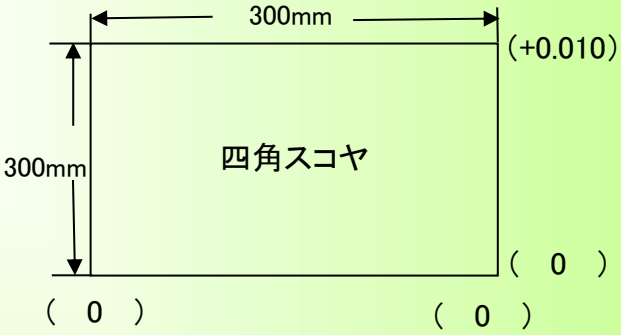

上面精度
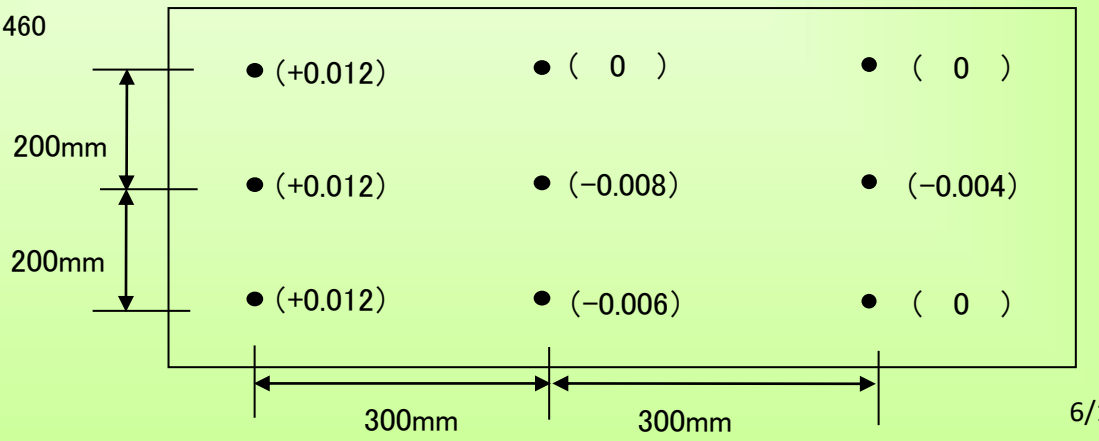
※テーブルサイズ　1000×460