



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	2007年製	バーコード	P007155
型式	V22	測定者	野辺沼	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


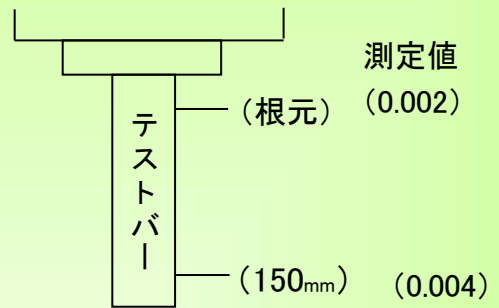
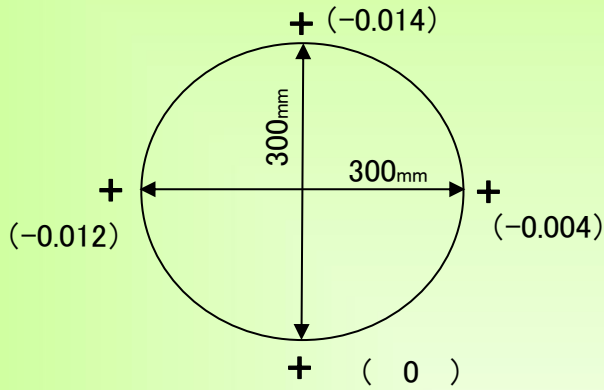


直角度

【YZ】測定値 (0.010)

【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.006)

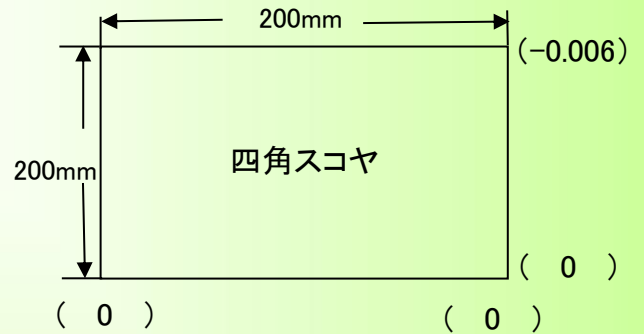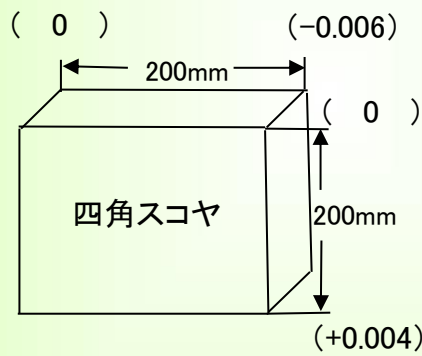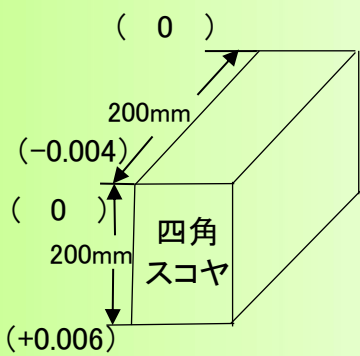

上面精度

※テーブルサイズ 450×350

