


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ヤマザキマザック	年式	1998年製	管理番号	P006921
型式	HTC-400	測定者	奥澤	アシスタント	

## Z軸方向の平行度

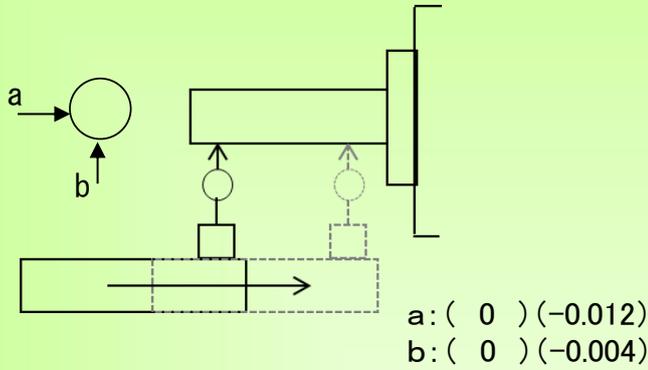

## 主軸振れ



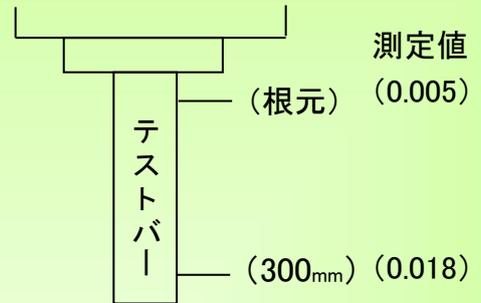


## 直角度

【XY】測定値 (0.004)

【ZY】測定値 (0.008)

【ZX】測定値 (0.004)

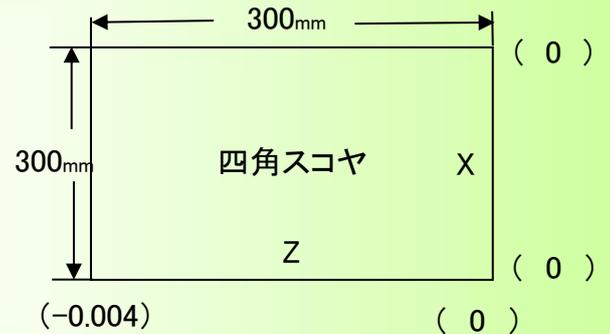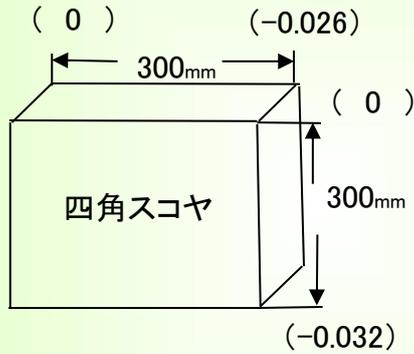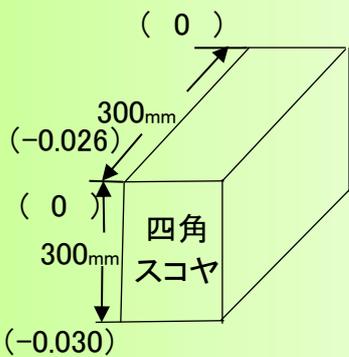

## 上面精度

テーブルサイズ: 400角

( )パレット1

[ ]パレット2

