精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	碌々産業	バーコード	P5199
型式	MEGA-360		

精度評価		コメント
Ⓐ	0～0.02㎜	精度良好です
B	0～0.03㎜	
C	0～0.04㎜	
D	0～0.05㎜	

振り回し（300ピッチ）

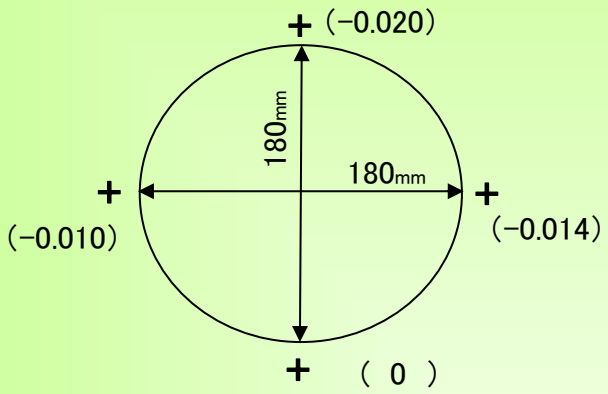

主軸振れ

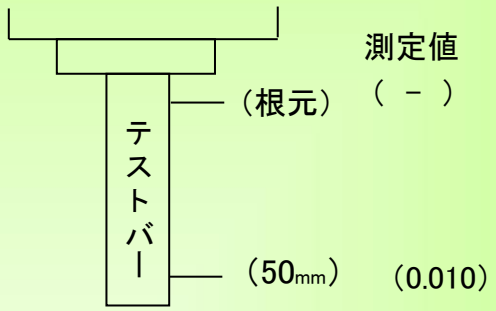

直角度

【Y Z】測定値 (0.014)

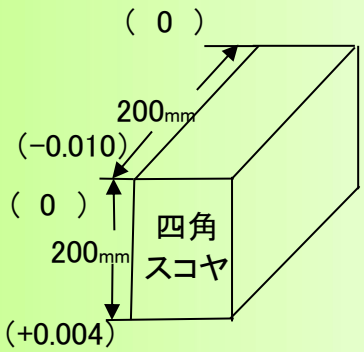

【X Z】測定値 (0.014)

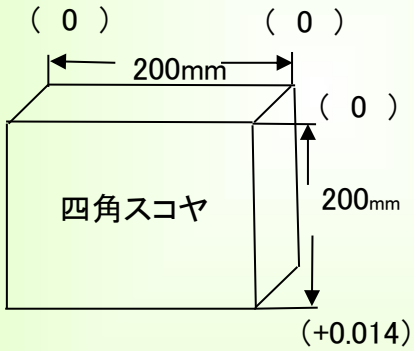

【X Y】測定値 (0.010)

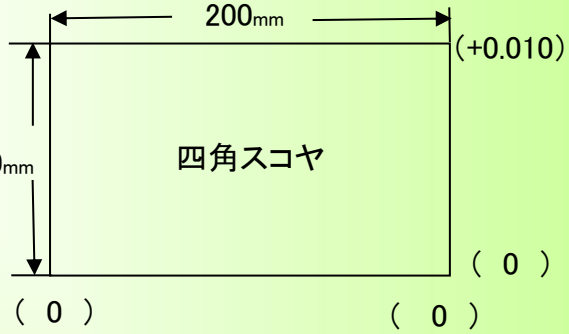

上面精度

※テーブルサイズ　600×330

テーブル上面の平行度		
500以下	0.020	○
500を超え800以下	0.025	
800を超え1250以下	0.030	
1250を超え2000以下	0.040	

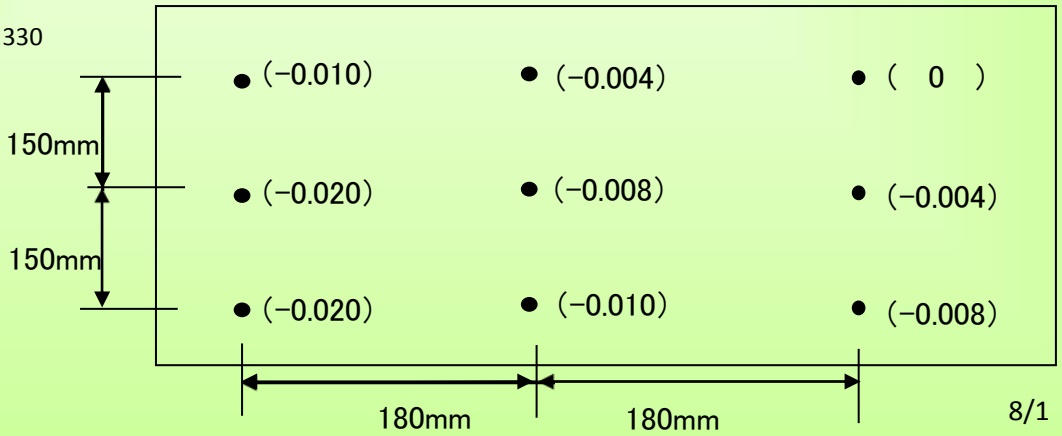

8/1