精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	森精機	管理番号	P5796
型式	SVD-403		

精度評価		コメント
Ⓐ	0 ～0.02㎜	精度良好です
B	0 ～0.03㎜	
C	0 ～0.04㎜	
D	0 ～0.05㎜	

振り回し（300ピッチ）

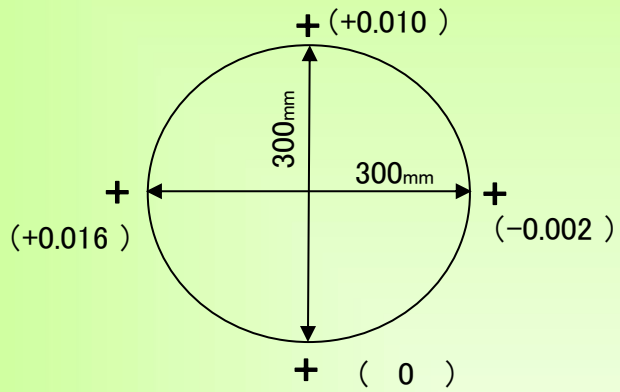

主軸振れ

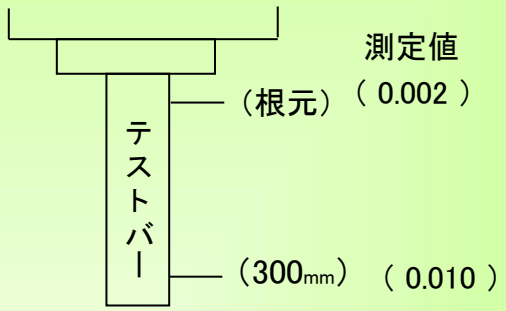

直角度

【Y Z】測定値 (0.012)　【X Z】測定値 (0.010)　【X Y】測定値(0.006)

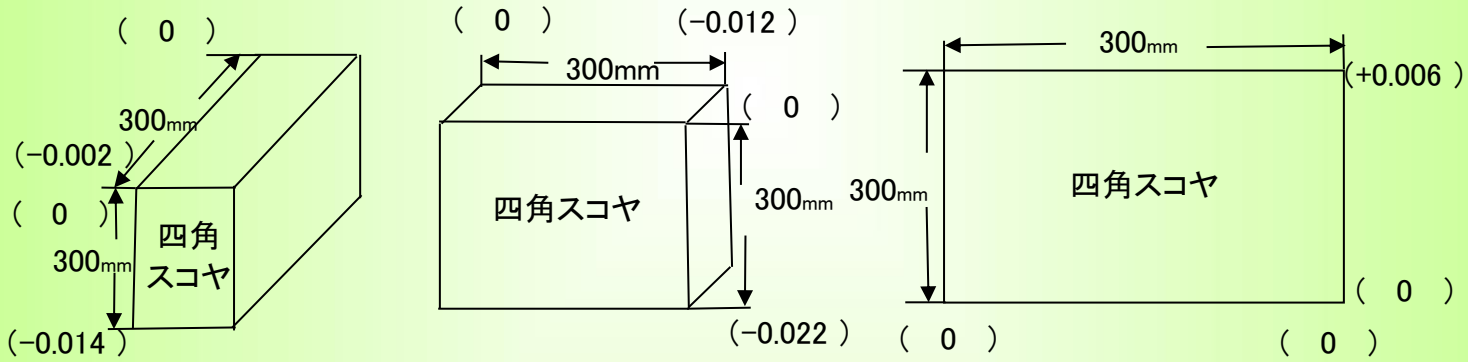

上面精度

※テーブルサイズ 500 × 900
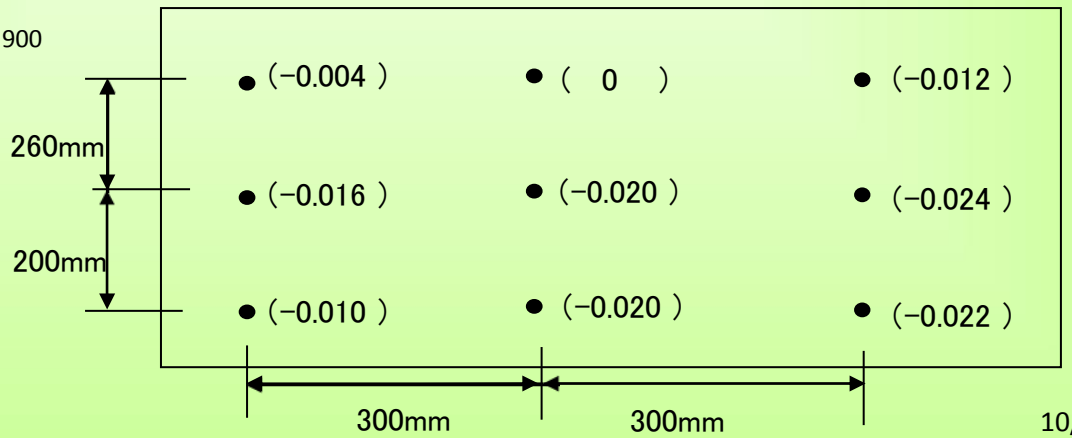
テーブル上面の平行度		
500以下	0.020	
500を超え800以下	0.025	○
800を超え1250以下	0.030	
1250を超え2000以下	0.040