# 精度測定検査表

*Examination for precision list*

| メーカー | 日立精機 | 管理番号 | P5344 |
|---|---|---|---|
| 型式 | VS40 | | |

| 精度評価 | | コメント |
|---|---|---|
| Ⓐ | 0 ～0.02㎜ | 良好です |
| B | 0 ～0.03㎜ | |
| C | 0 ～0.04㎜ | |
| D | 0 ～0.05㎜ | |

## 振り回し（300ピッチ）

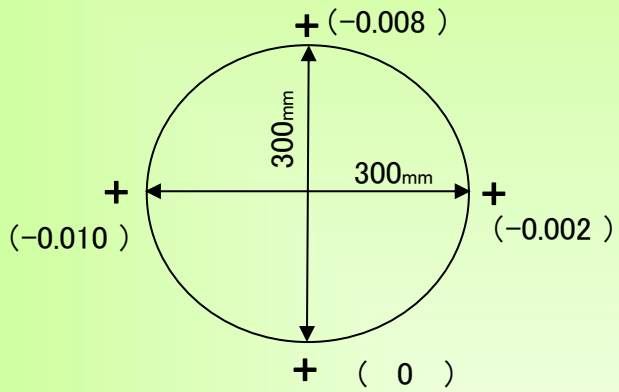


## 主軸振れ

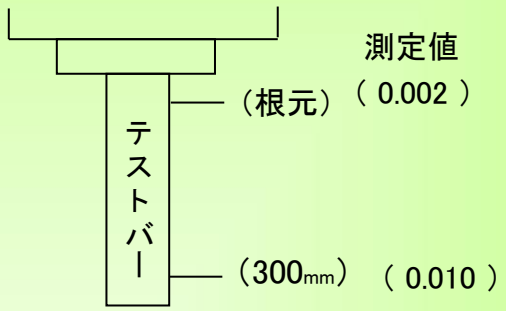


## 直角度

【Y Z】測定値（ 0.010 ）　【X Z】測定値 （ 0.012 ）　【X Y】測定値（ 0.006 ）

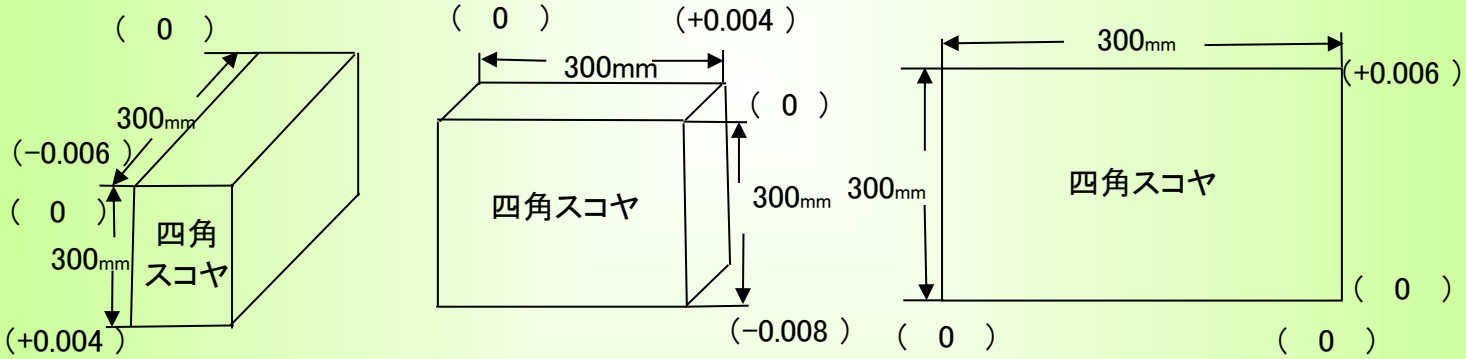


## 上面精度

※テーブルサイズ　900　× 450
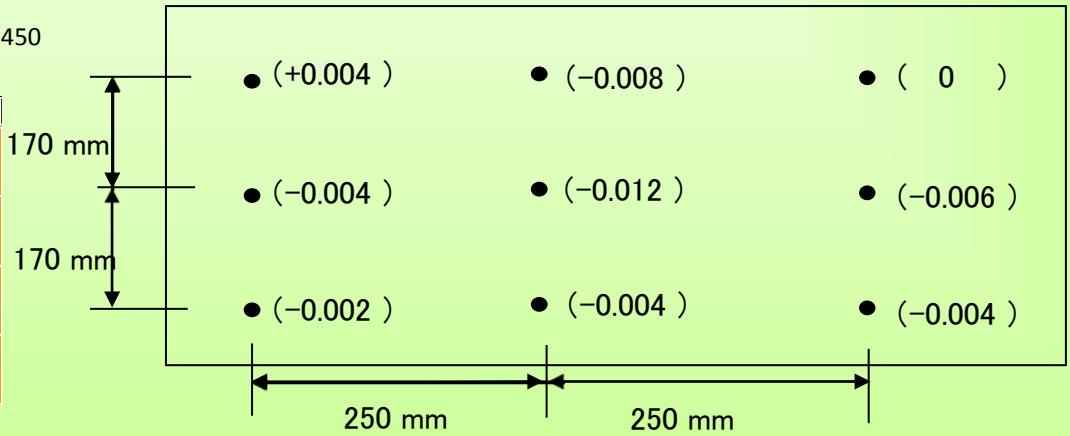
| テーブル上面の平行度 | | |
|---|---|---|
| 500以下 | 0.020 | |
| 500を超え800以下 | 0.025 | ○ |
| 800を超え1250以下 | 0.030 | |
| 1250を超え2000以下 | 0.040 | |