



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2005年製	バーコード	P007145
型式	TC-S2B	測定者		アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

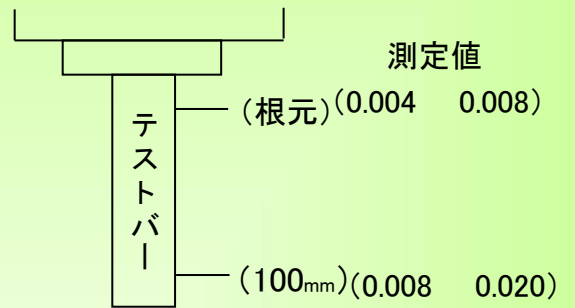
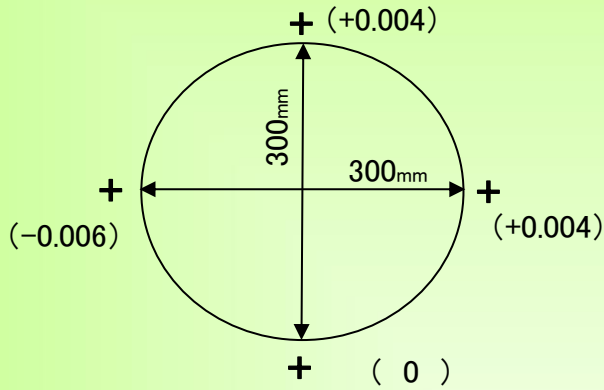


直角度

【YZ】測定値 (0.014)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.008)

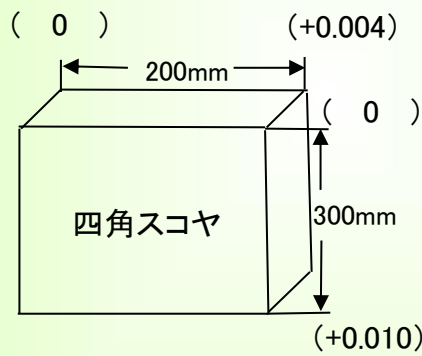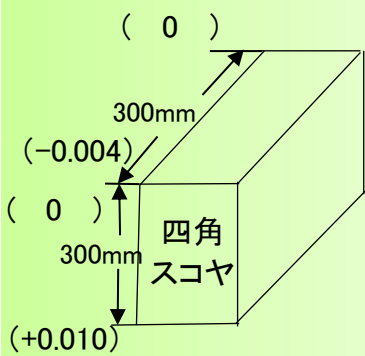

上面精度

※テーブルサイズ 600×300

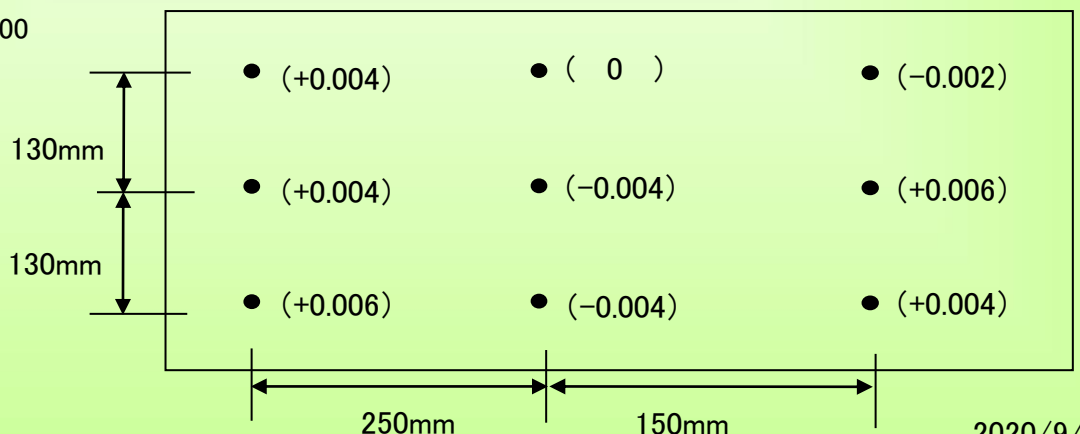

2020/9/30