


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2005年製	バーコード	P007144
型式	TC-S2B	測定者		アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

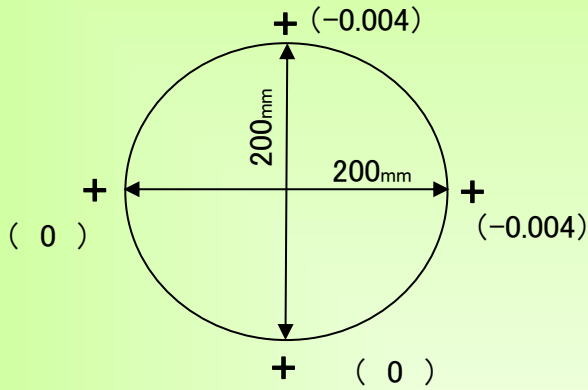

主軸振れ



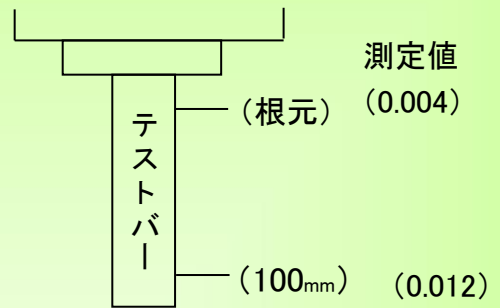


直角度

【YZ】 測定値 (0.020)


【XZ】 測定値 (0.004)

【XY】 測定値 (0.010)

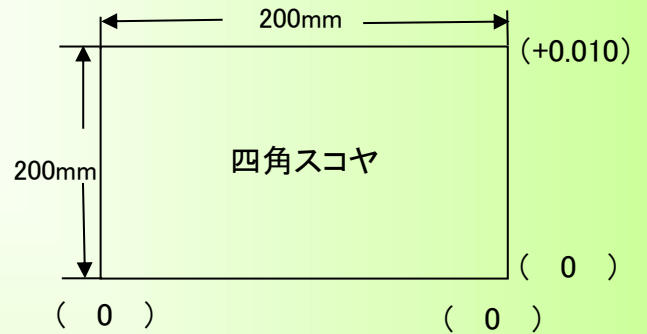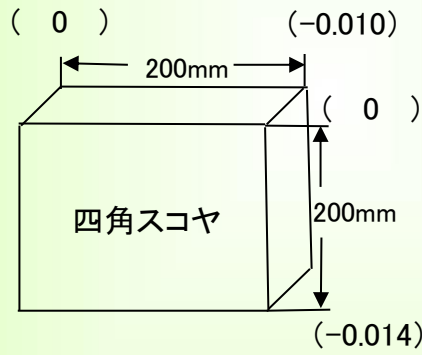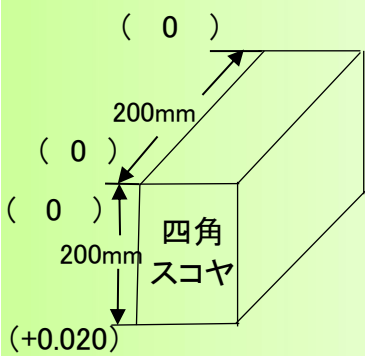

上面精度

※テーブルサイズ 600×300

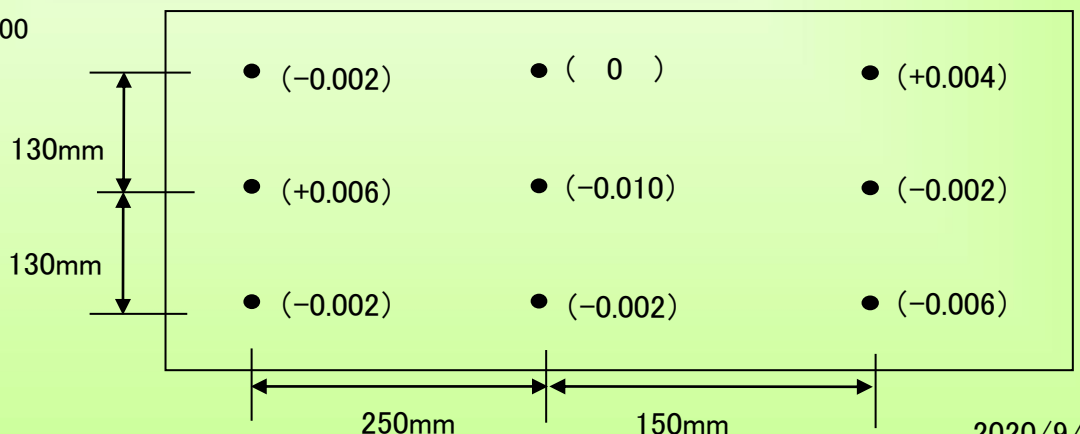

2020/9/30