



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2006年製	バーコード	P007090
型式	VM5III	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

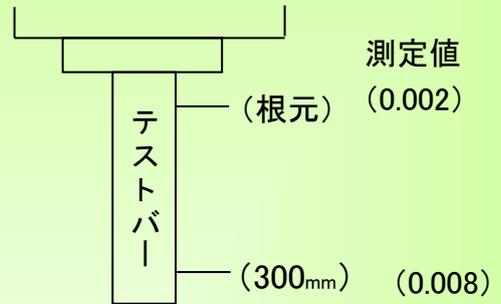
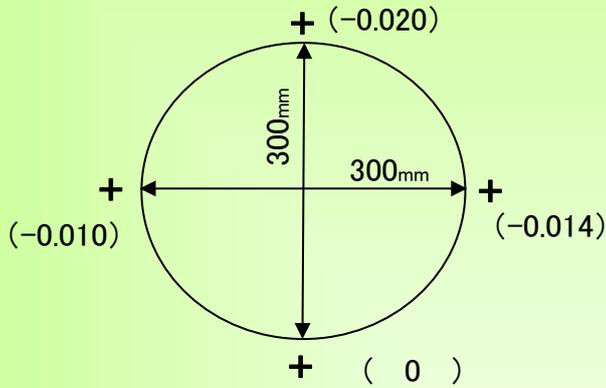


直角度

【YZ】測定値 (0.014)

【XZ】測定値 (0.008)

【XY】測定値 (0.004)

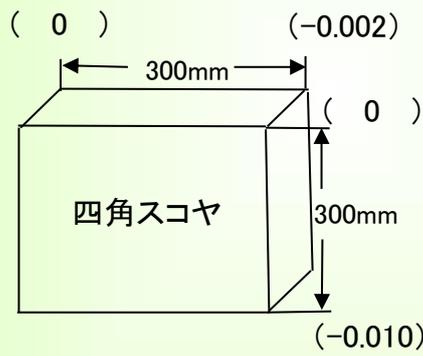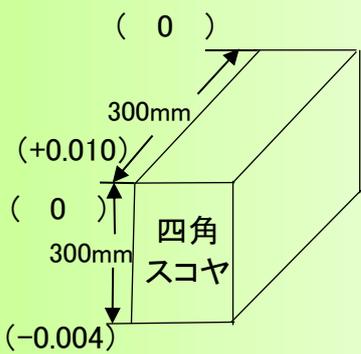

上面精度

※テーブルサイズ 1050×560

