



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ヤマザキマザック	年式	2010年製	バーコード	P006887
型式	VARIAXIS500-5X II	測定者	平野	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

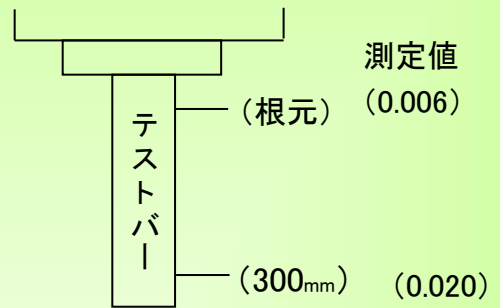
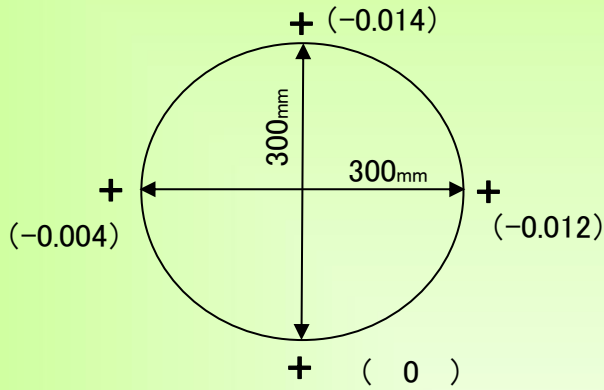


直角度

【YZ】測定値 (0.008)

【XZ】測定値 (0.014)

【XY】測定値 (0.006)

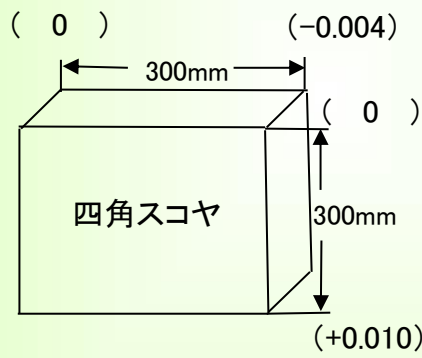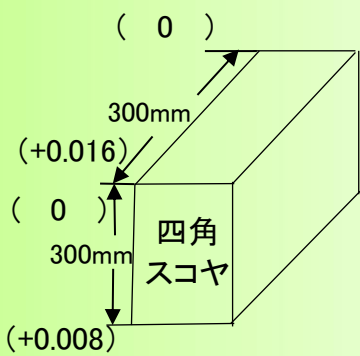

上面精度

※テーブルサイズ φ500 × 巾400

