



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2003年製	管理番号	P007020
型式	VS50/40	測定者	前田	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


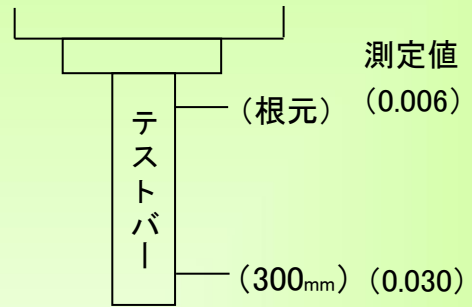
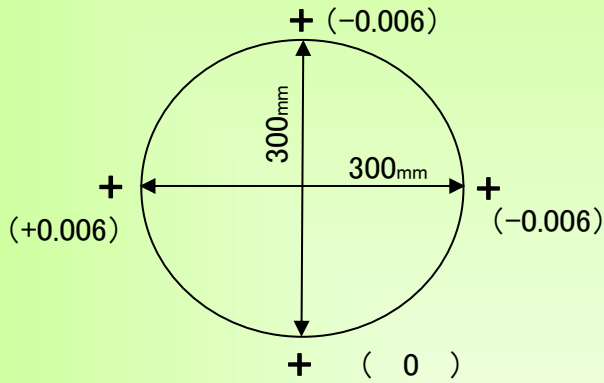


直角度

【YZ】 測定値 (0.012)


【XZ】 測定値 (0.004)

【XY】 測定値 (0.004)

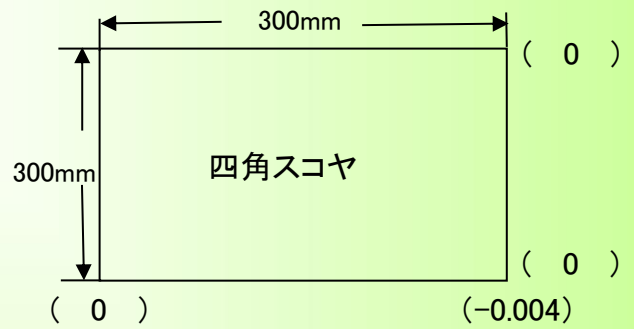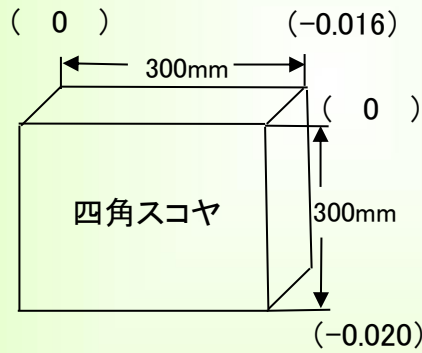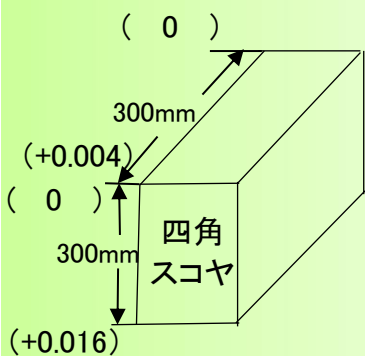

上面精度

※テーブルサイズ 1120×510

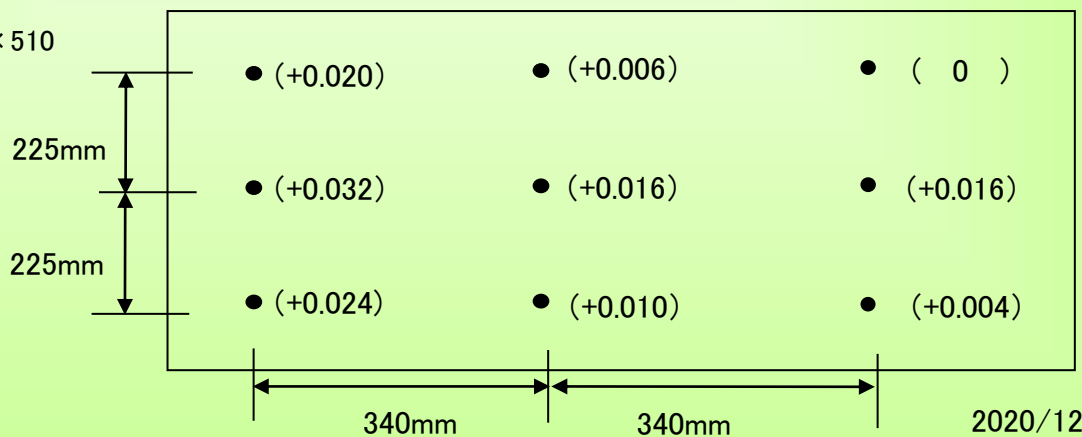

2020/12/12