


# 精度測定検査表


*Examination for precision list*

メーカー	ツガミ	年式	1983年製	バーコード	H014142
型式	GU25	測定者	小林将	アシスタント	


## 主軸とz軸の平行度

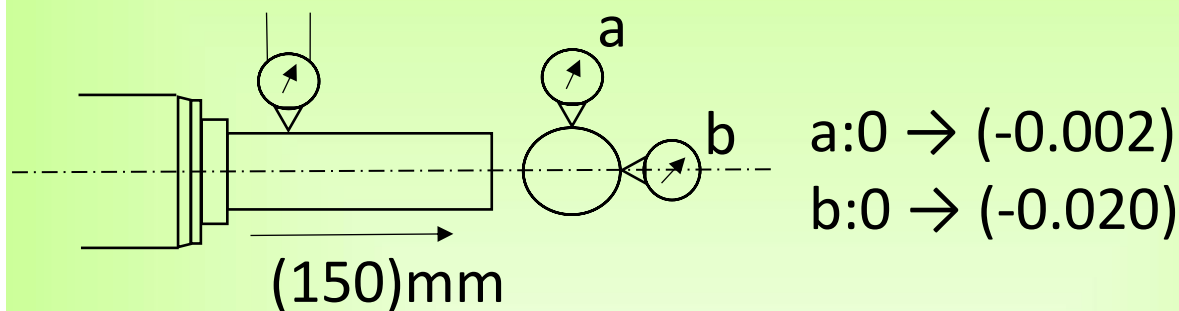

## 心押しとz軸の平行度

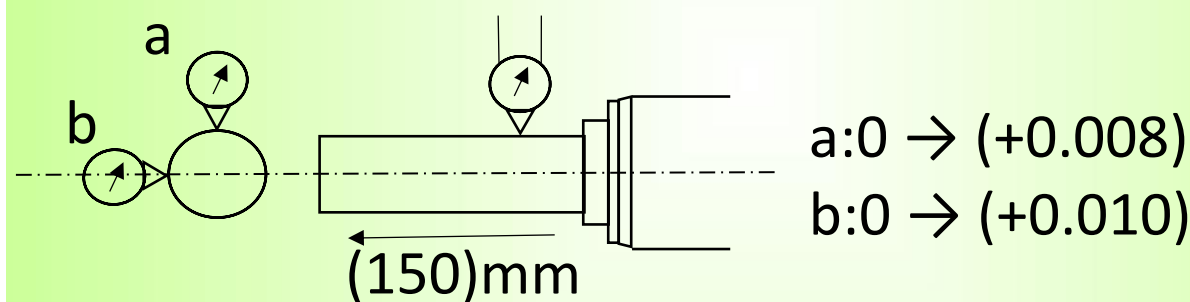

## テスト加工

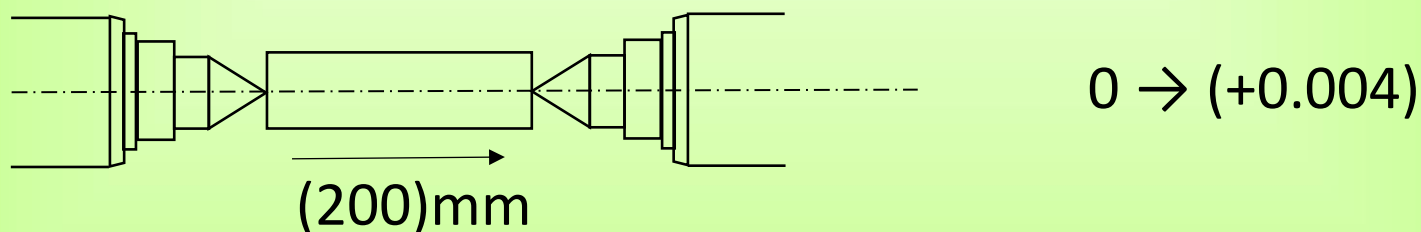

2021/3/30