精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	管理番号	P6127
型式	V56		

精度評価		コメント
Ⓐ	0～0.02㎜	精度良好です。
B	0～0.03㎜	
C	0～0.04㎜	
D	0～0.05㎜	

振り回し（300ピッチ）

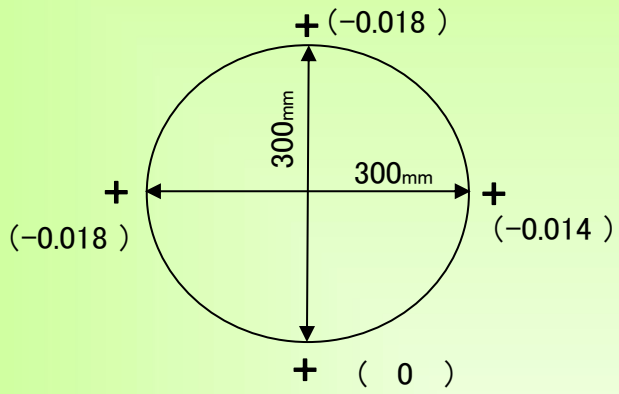

主軸振れ

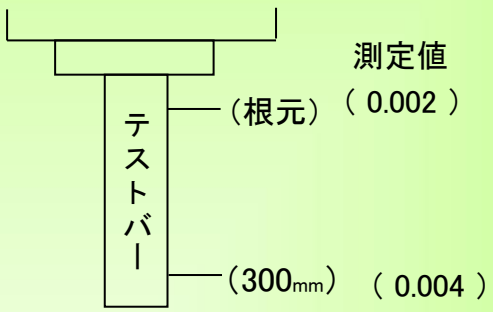

直角度

【Y Z】測定値（ 0.010 ）　【X Z】測定値 （ 0.012 ）　【X Y】測定値（ 0.008 ）

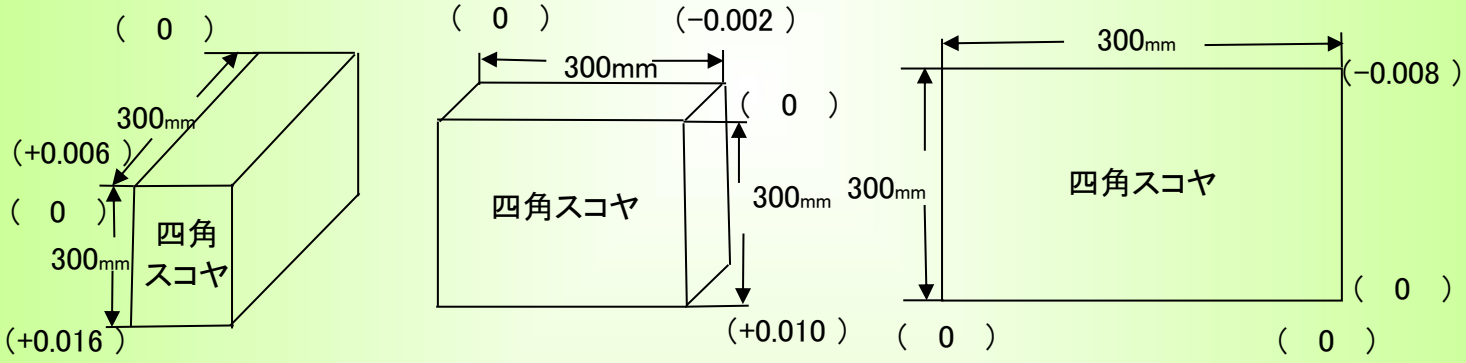

上面精度

バックラッシュ　X:0.002　Y:0.004　Z:0.002

※テーブルサイズ　550×1050
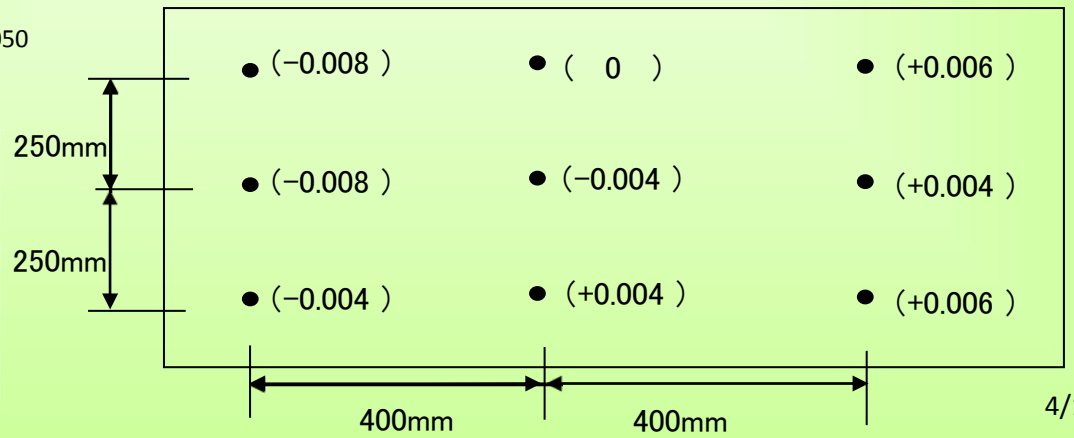
テーブル上面の平行度		
500以下	0.020	
500を超え800以下	0.025	○
800を超え1250以下	0.030	
1250を超え2000以下	0.040