


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2003年製	管理番号	P006709
型式	α-T14iD	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

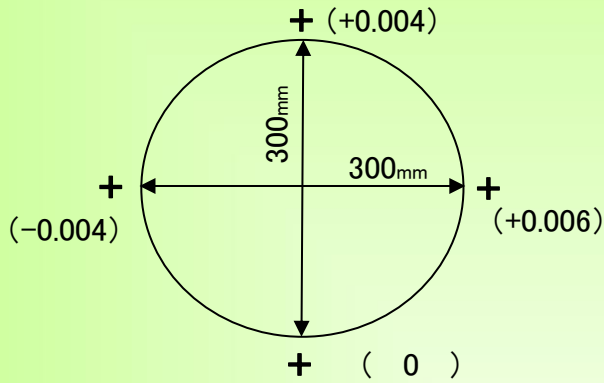

主軸振れ



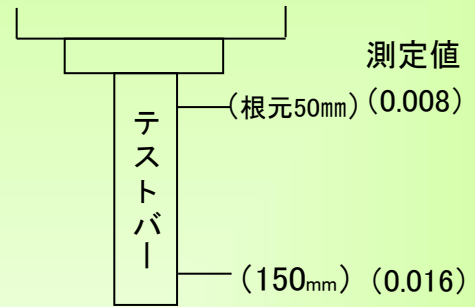


直角度

【YZ】測定値 (0.014)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.006)

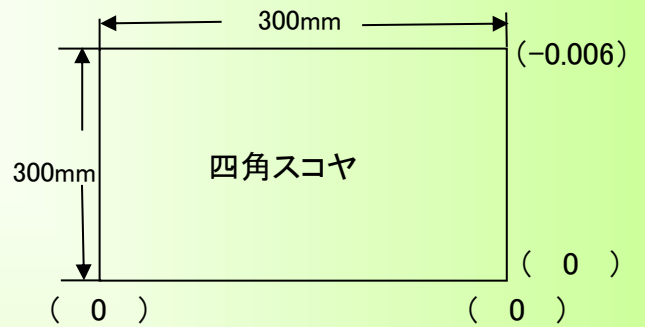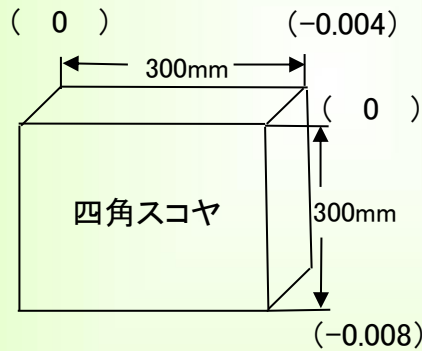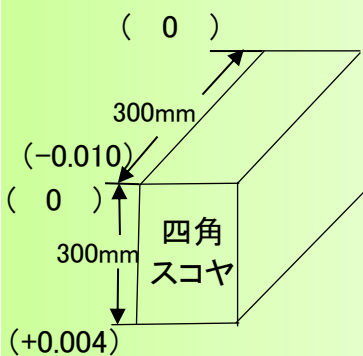

上面精度

※テーブルサイズ 650×400

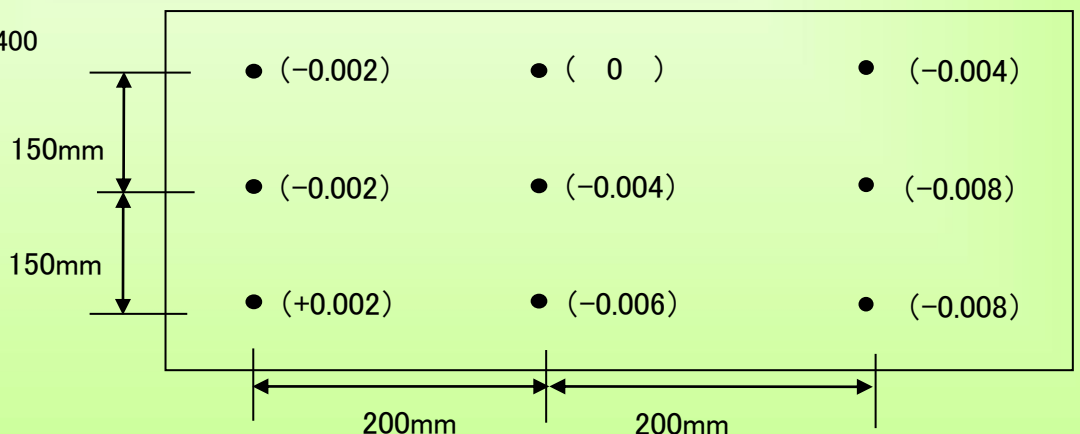

2021/5/7