


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2003年製	管理番号	P006712
型式	α -T14iD	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

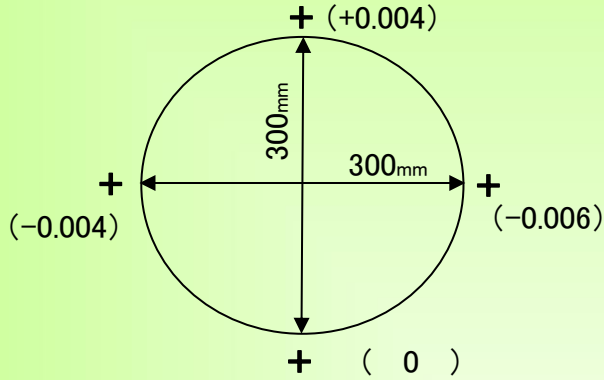

主軸振れ



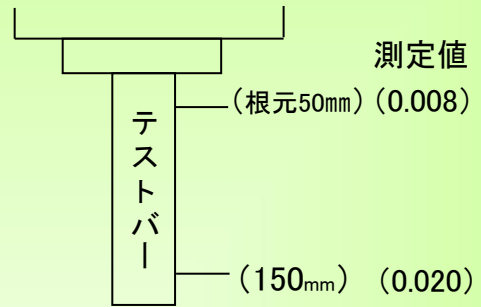


直角度

【YZ】 測定値 (0.006)


【XZ】 測定値 (0.006)

【XY】 測定値 (0.014)

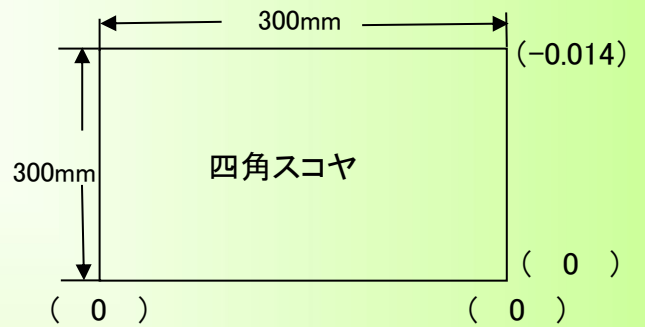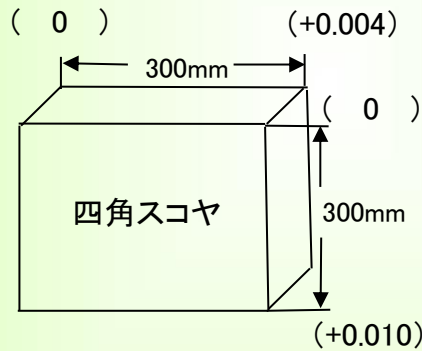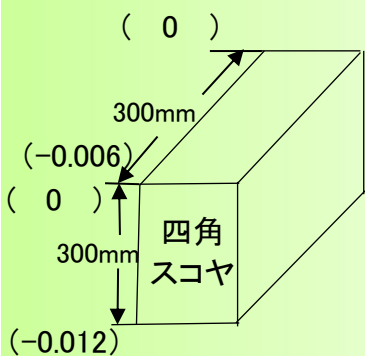

上面精度

※テーブルサイズ 650×400

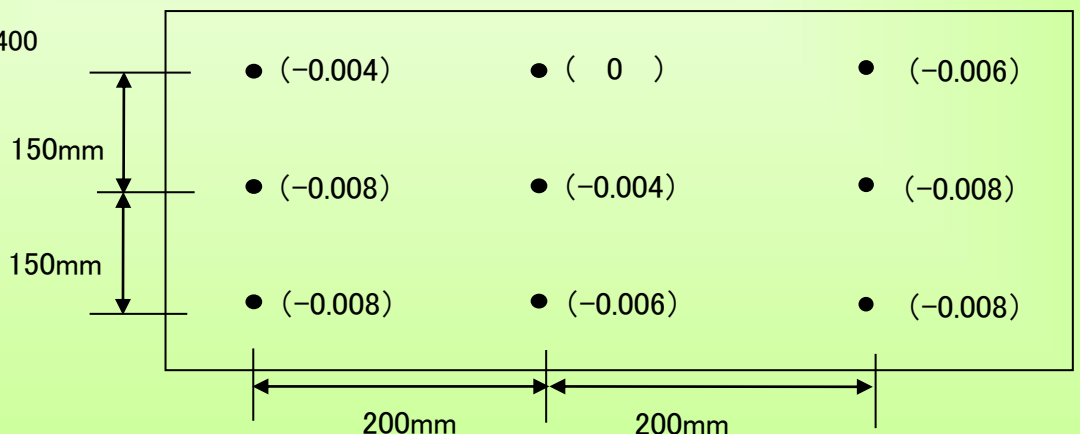

2021/5/26