


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2001年製	バーコード	P005948
型式	α-T14iBL		測定者	武藤	アシスタント

振り回し(300ピッチ)

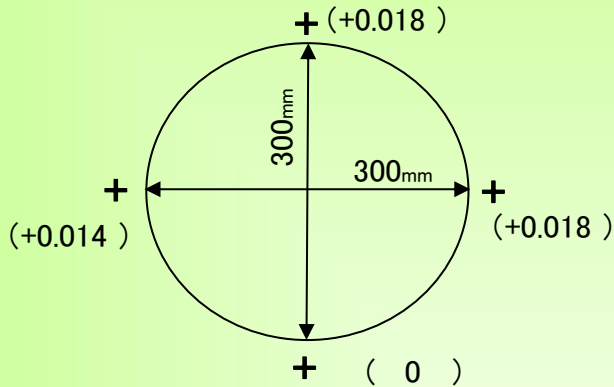

主軸振れ



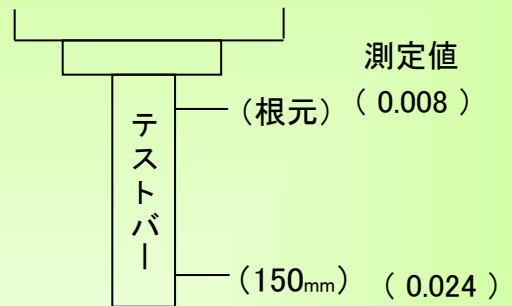


直角度

【Y Z】測定値 (0.006)

【X Z】測定値 (0.016)

【X Y】測定値 (0.008)

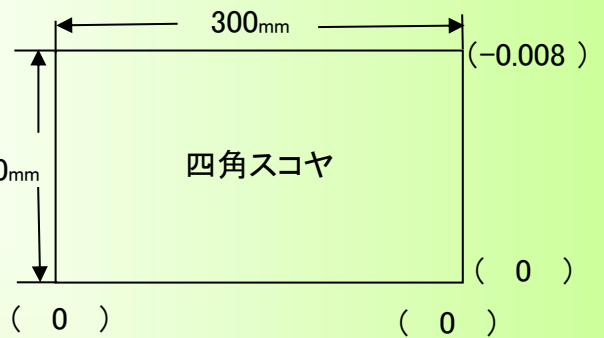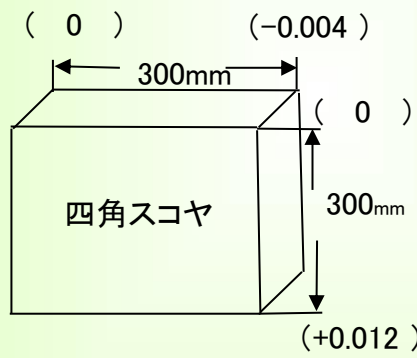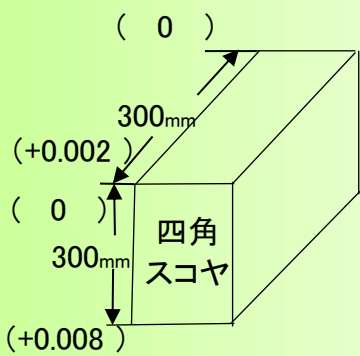

上面精度

※テーブルサイズ 850×410

