


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	山崎技研	年式	2005年製	管理番号	H017521
型式	YZ-500WR	測定者	仙田	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

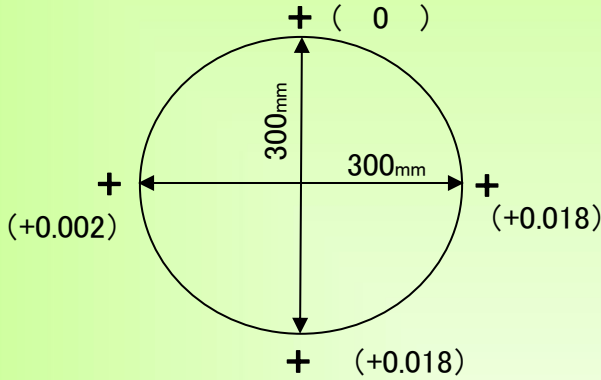

主軸振れ



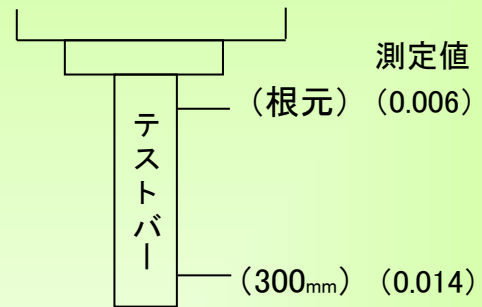


直角度

【YZ】測定値 (0.020)


【XZ】測定値 (0.024)

【XY】測定値 (0.018)

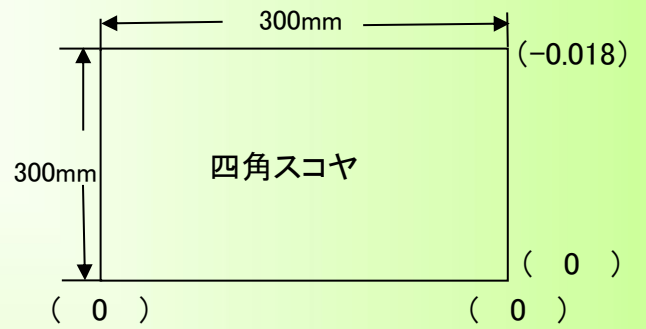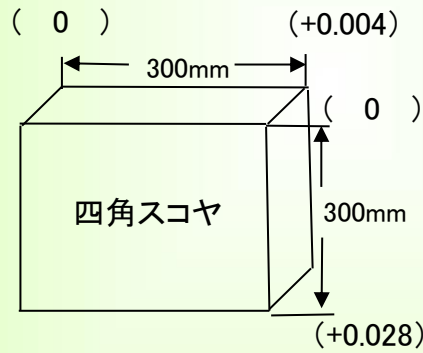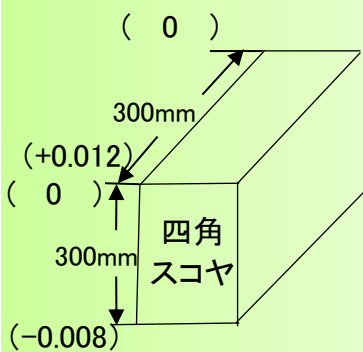

上面精度

※テーブルサイズ 1600×500

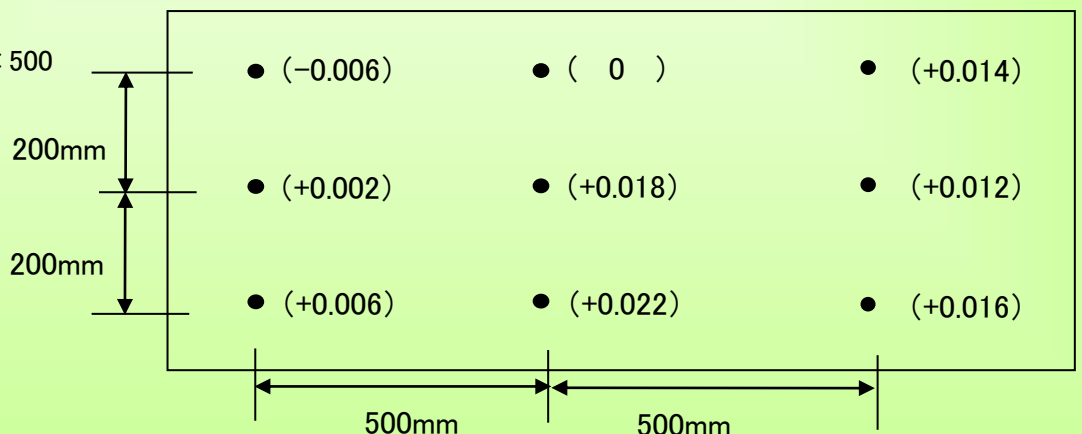

2023/2/21