


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2004年製	バーコード	P006491
型式	FMR-30		測定者	奥澤	アシスタント

振り回し(170ピッチ)



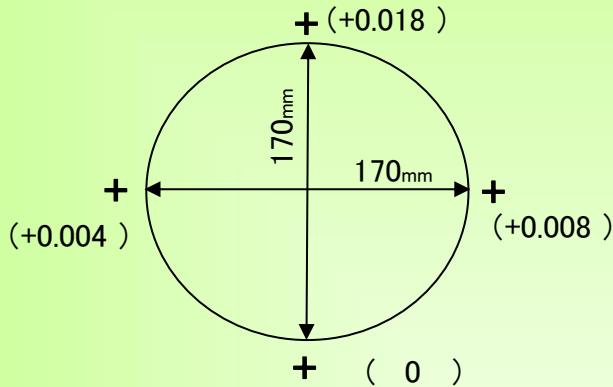


主軸振れ

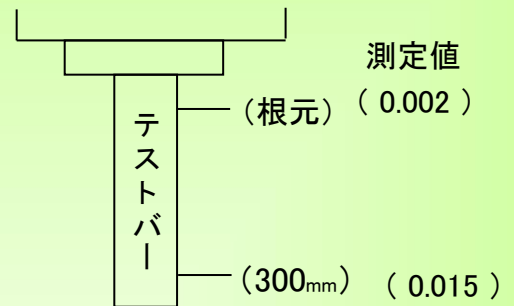

直角度

【Y Z】測定値 (0.024) 【X Z】測定値 (0.008) 【X Y】測定値 (0.004)

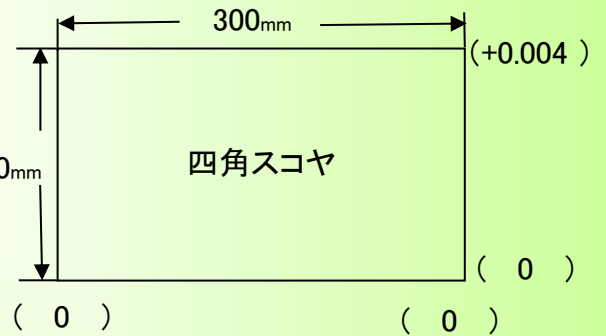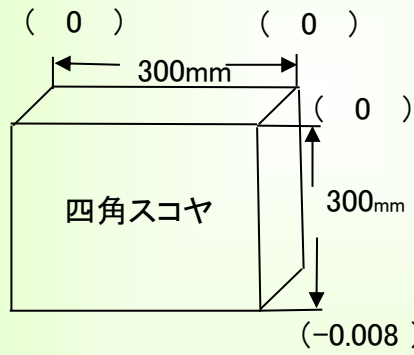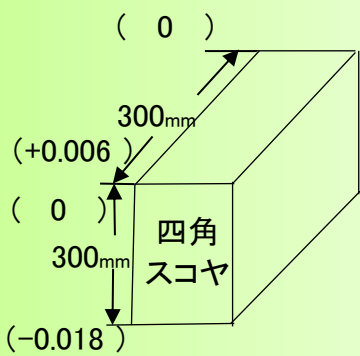

上面精度

※テーブルサイズ 1350×310

