



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2007年	管理番号	P008075
型式	VP600	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

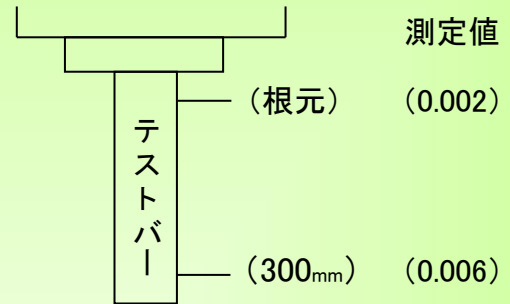
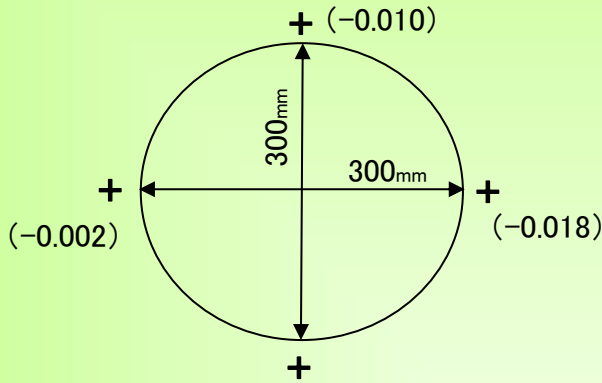


直角度

【YZ】 測定値 (0.006)


【XZ】 測定値 (0.010)

【XY】 測定値 (0.006)

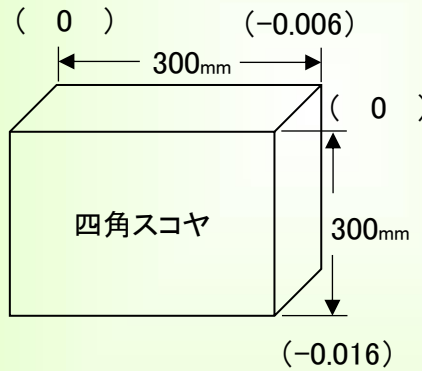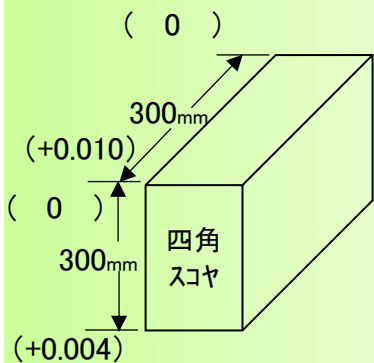

上面精度

※テーブルサイズ 610×1300

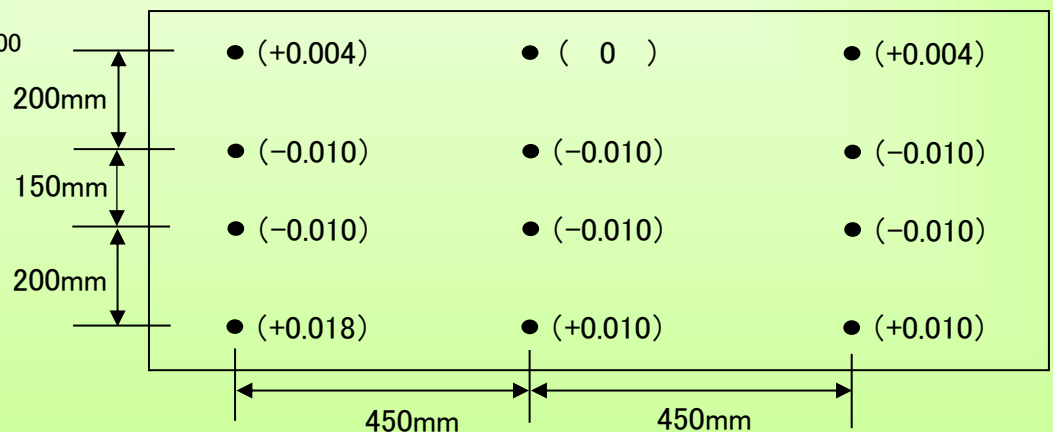

2023/4/6