


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ヤマザキマザック	年式	2005年	管理番号	P008155
型式	VTC-200B	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

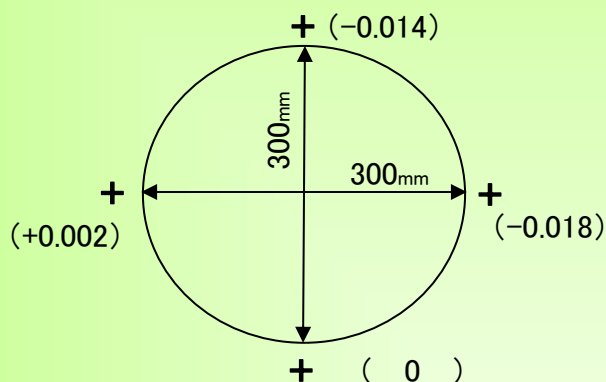

主軸振れ



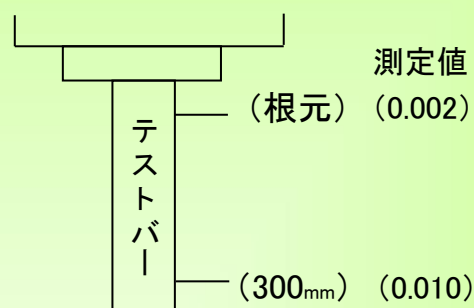


直角度

【YZ】測定値 (-0.002)


【XZ】測定値 (0.014)

【X Y】測定値 (0.006)

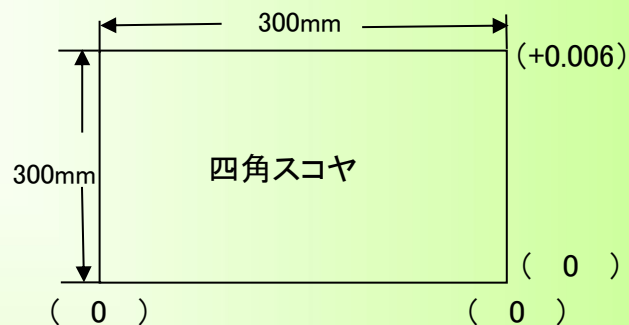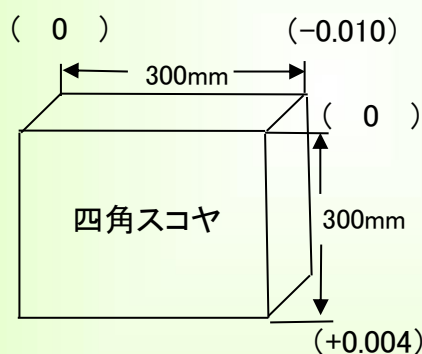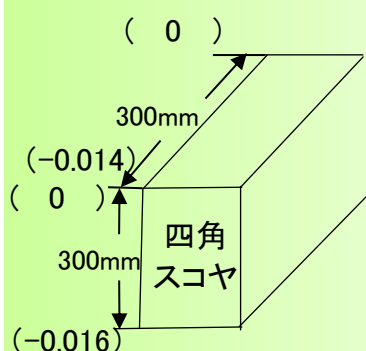

上面精度

※テーブルサイズ 1460 × 510

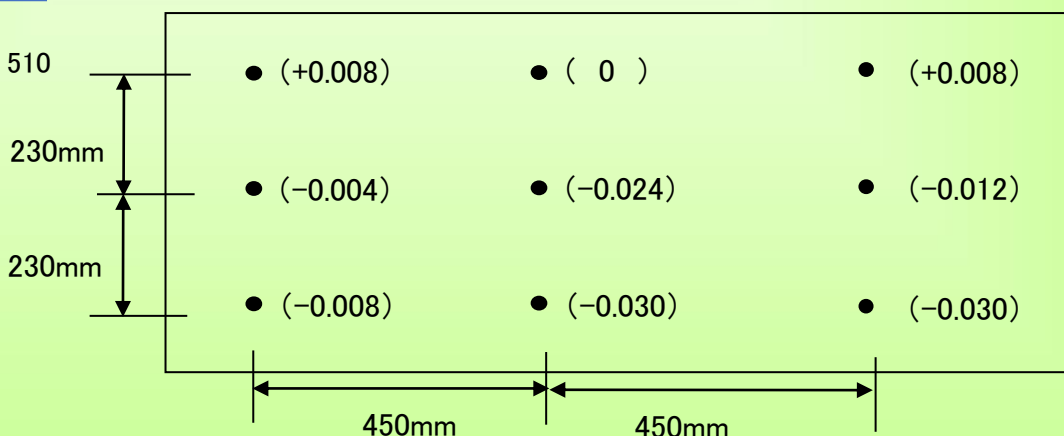

2023/5/25