精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2007年製		バーコード	P006503
型式	NH4000DCG(3ﾊﾟﾚ)	当社評価	A	測定者	金子	アシスタント

Z軸方向の平行度

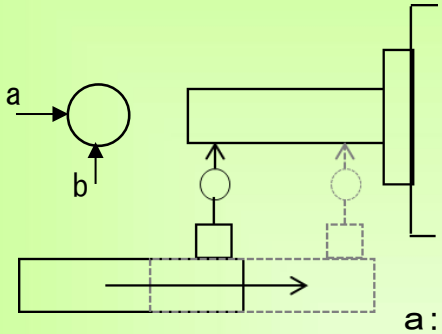

a:（ 0 ）（ 0.004 ）
b:（ 0 ）（ 0.004 ）

主軸振れ

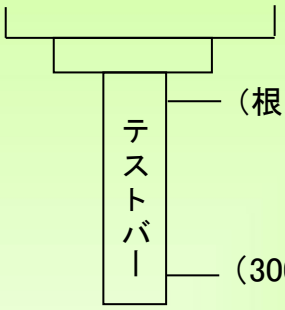

測定値
（根元）（ 0.004 ）
（300mm）（ 0.014 ）

直角度

【XY】測定値（ 0.004 ）

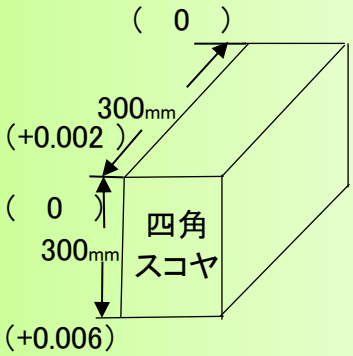

【ZY】測定値（ 0.006 ）

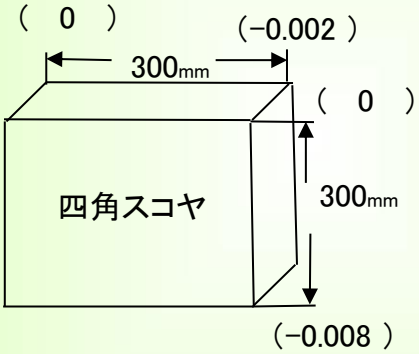

【ZX】測定値（ 0.004 ）

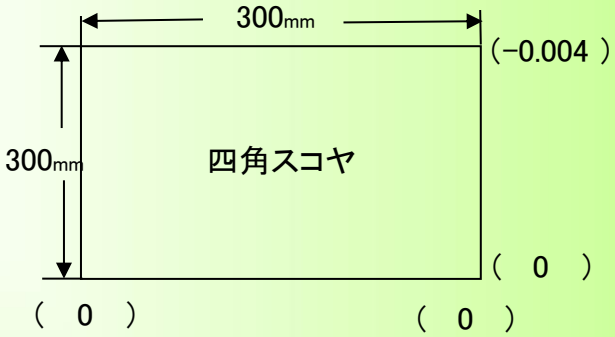

上面精度

ﾃｰﾌﾞﾙｻｲｽﾞ： 400角

（ ）→パレット1
[ ] →パレット2

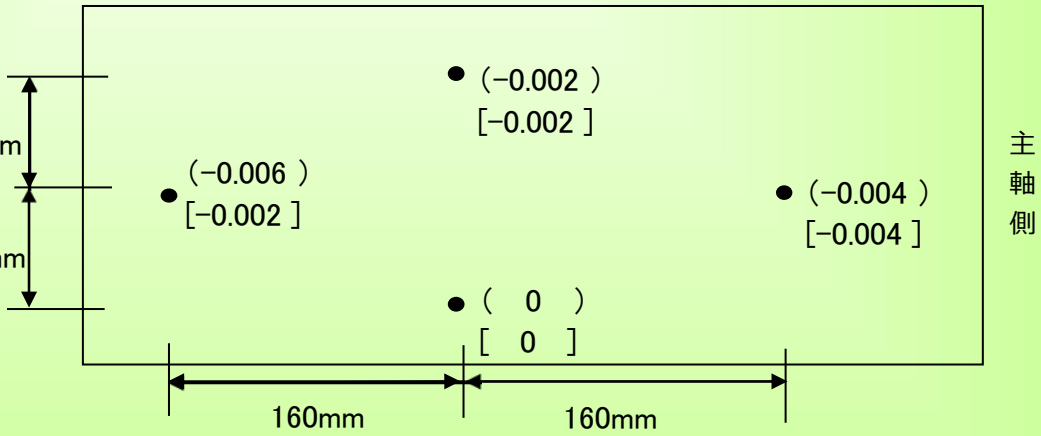

ﾊﾟﾚｯﾄ3