


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2005年製	バーコード	P006538
型式	MCV-560	当社評価	A	測定者	金子・野辺沼

## 振り回し(300ピッチ)

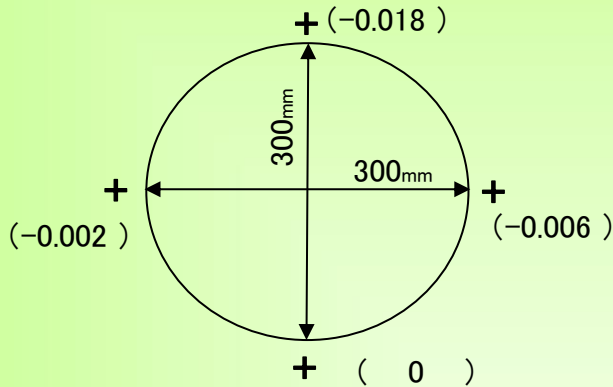

## 主軸振れ



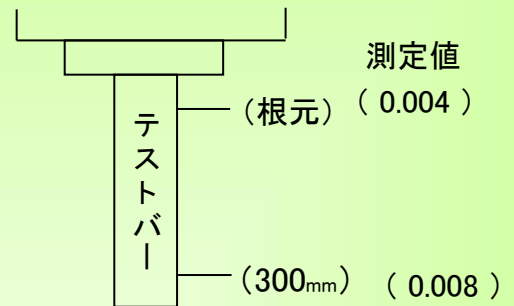


## 直角度

【Y Z】測定値 ( 0.010 )

【X Z】測定値 ( 0.004 )

【X Y】測定値 ( 0.012 )

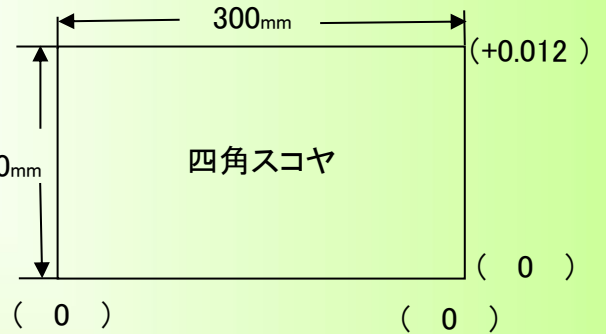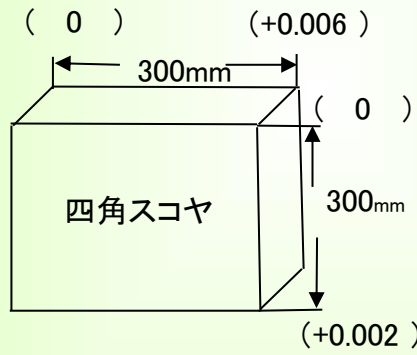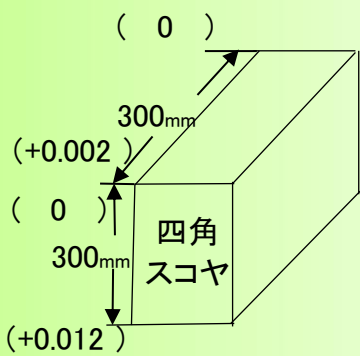

## 上面精度

※テーブルサイズ 1300×570

