


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	2004	管理番号	P008248
型式	VM5III	測定者	近藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

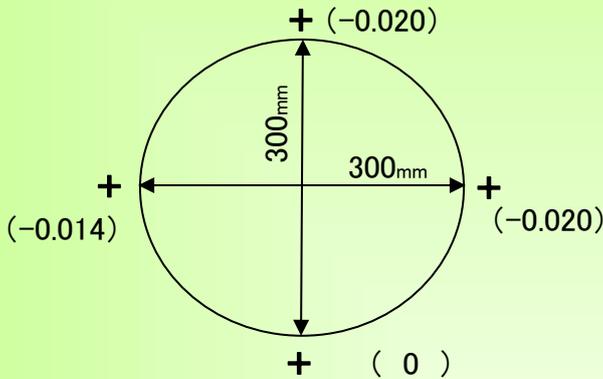

主軸振れ



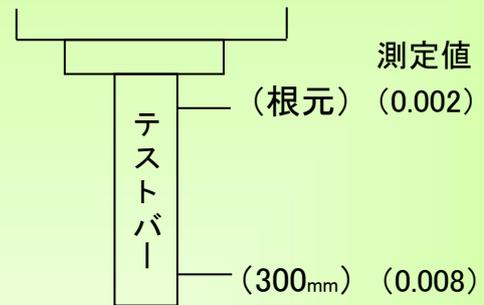


直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.002)

【XY】測定値 (0.010)

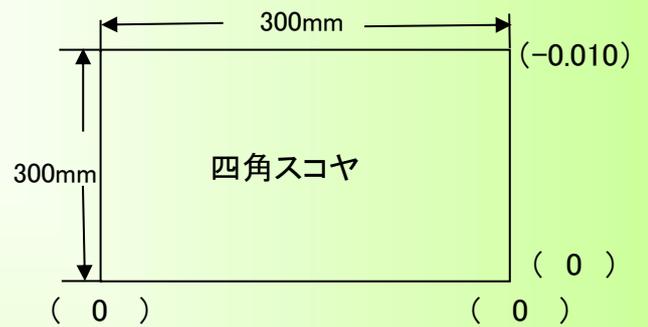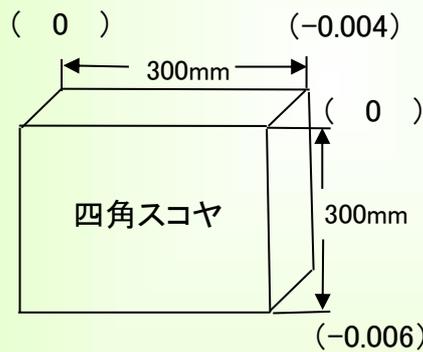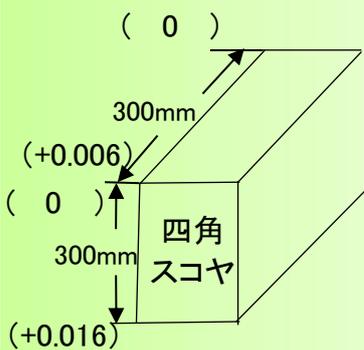

上面精度

※テーブルサイズ 1050 × 560

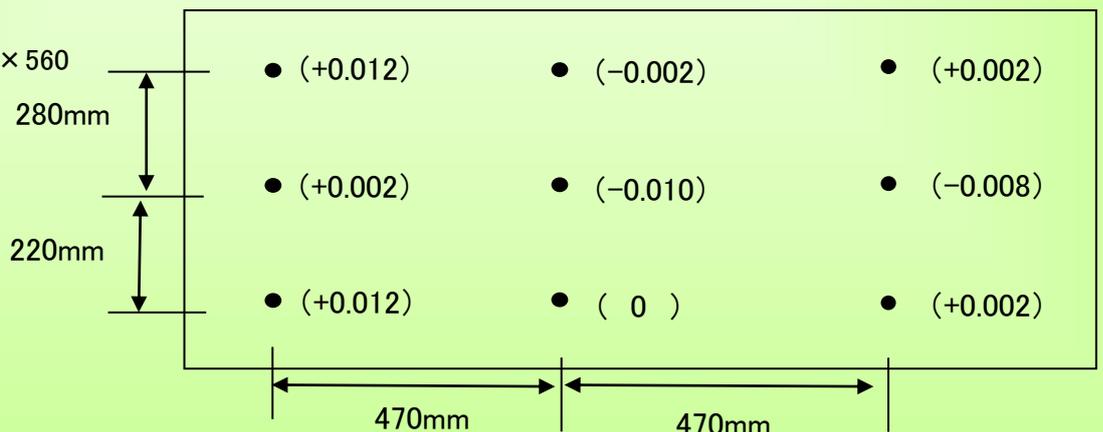

2023/9/6