


# 精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ブラザー	年式	2012年製	バーコード	P006562
型式	TC-S2DN	当社評価	A	測定者	金子 アシスタント

## 振り回し(300ピッチ)

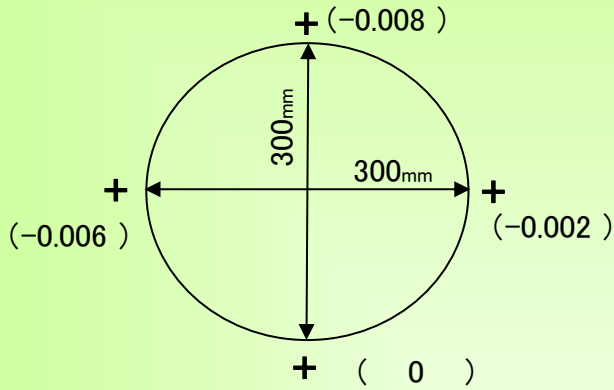

## 主軸振れ


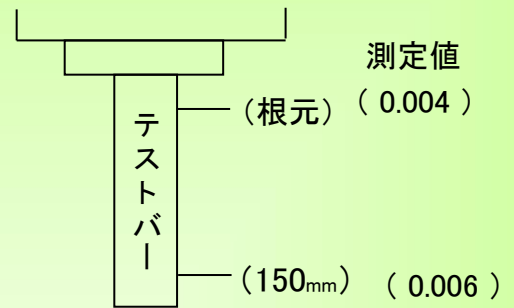


## 直角度

【Y Z】測定値 ( 0.008 )

【X Z】測定値 ( 0.006 )

【X Y】測定値 ( 0.014 )

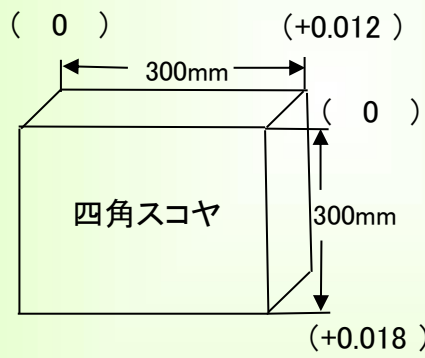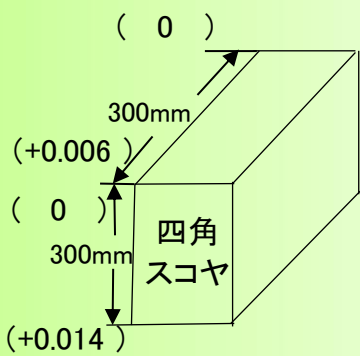

## 上面精度

※テーブルサイズ 600×400

