


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	1997	管理番号	P008322
型式	SH-400	測定者	金子	アシスタント	

Z軸方向の平行度

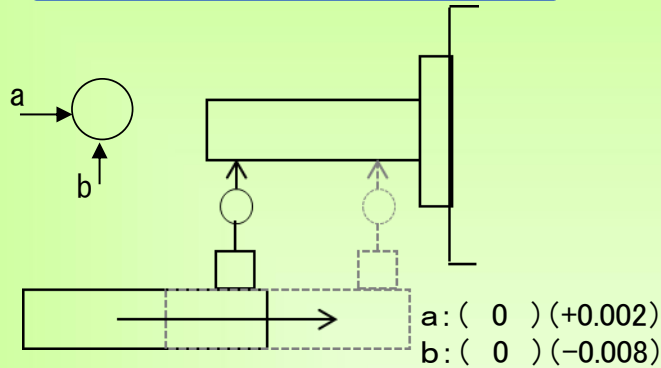

主軸振れ



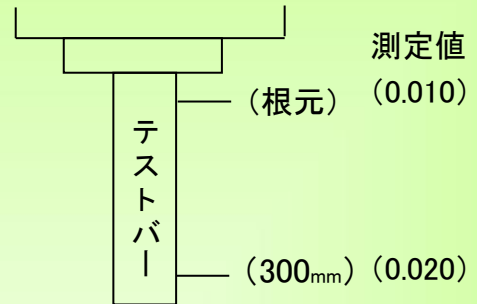


直角度

【XY】測定値 (0.006)

【ZY】測定値 (0.010)


【ZX】測定値 (0.010)

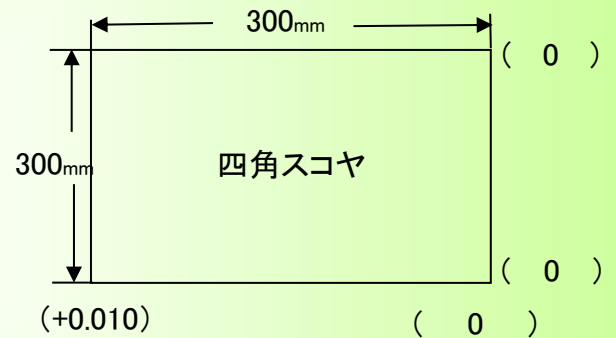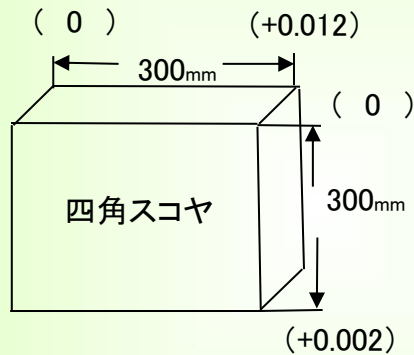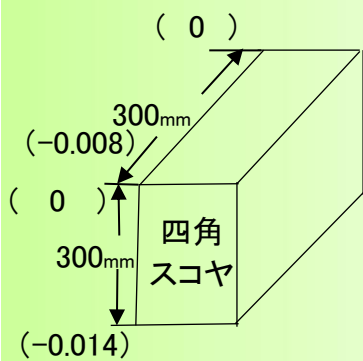

上面精度

テーブルサイズ: 400角

()パレット1
[]パレット2

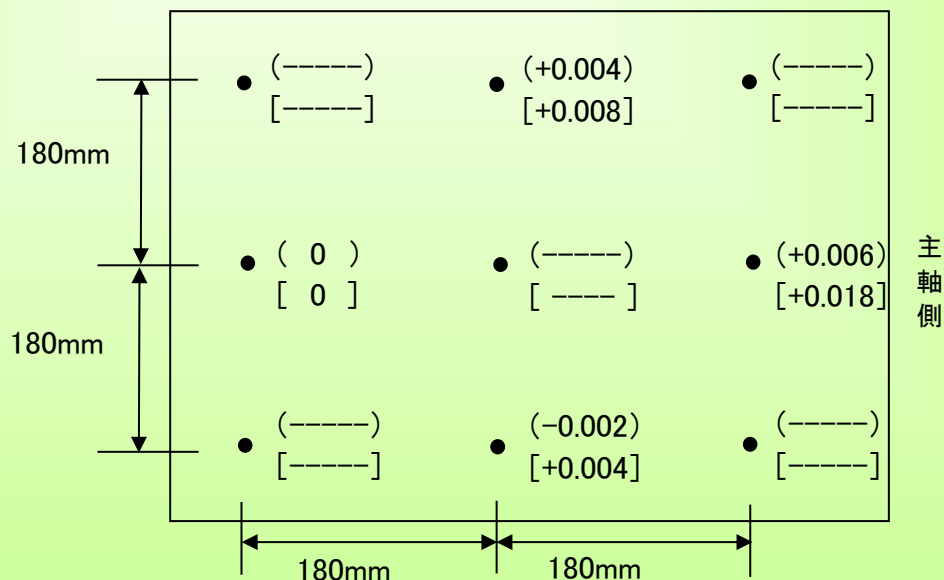

2023/11/2