


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	牧野フライス製作所	年式	1998	管理番号	P008407
型式	A55	測定者	野辺沼	アシスタント	

Z軸方向の平行度

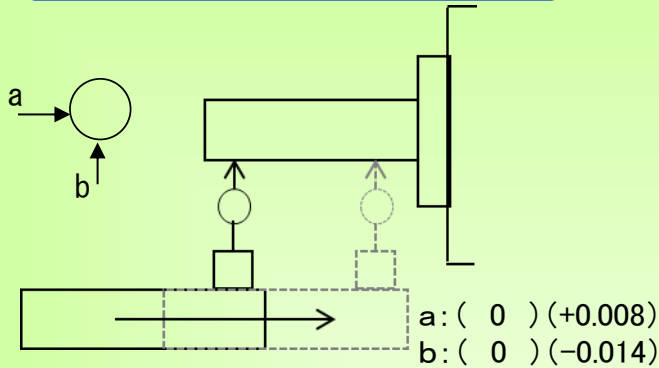

主軸振れ



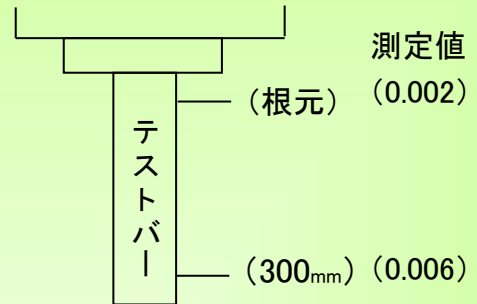


直角度

【XY】測定値 (0.006)

【ZY】測定値 (0.016)


【ZX】測定値 (0.004)

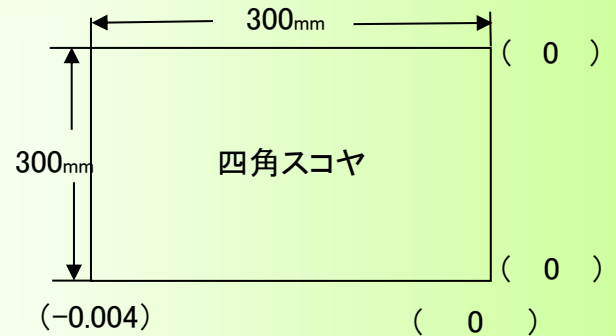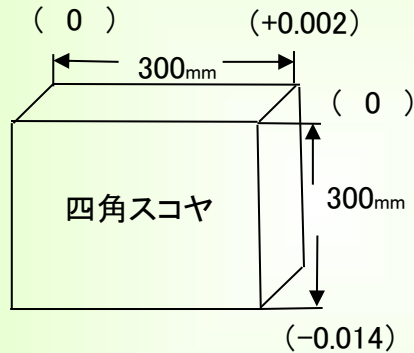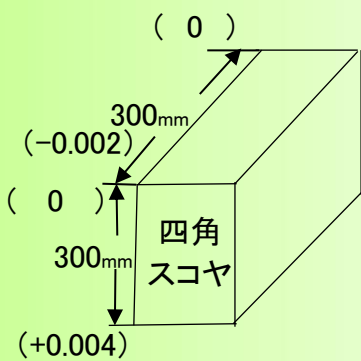

上面精度

テーブルサイズ: 400角

()パレット1
[]パレット2

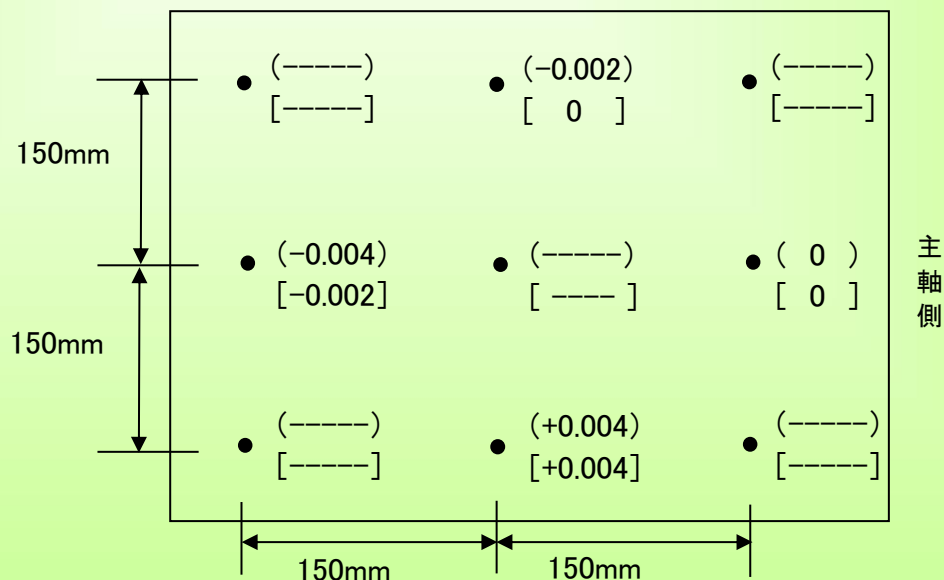

2023/11/17