


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2004	管理番号	P008394
型式	NH5000/50	測定者	武藤	アシスタント	

Z軸方向の平行度

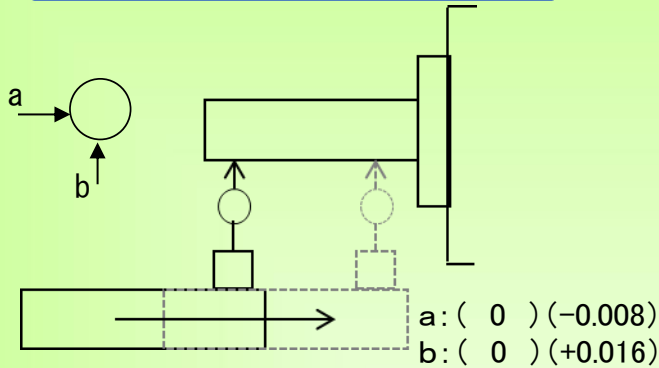

主軸振れ



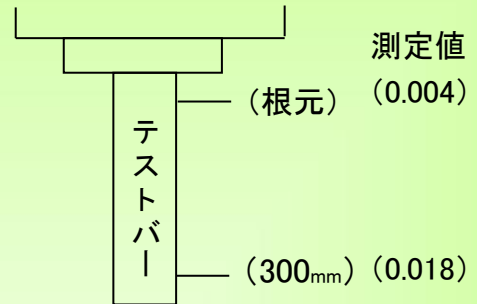


直角度

【XY】 測定値 (0.014)

【ZY】 測定値 (0.014)


【ZX】 測定値 (0.004)

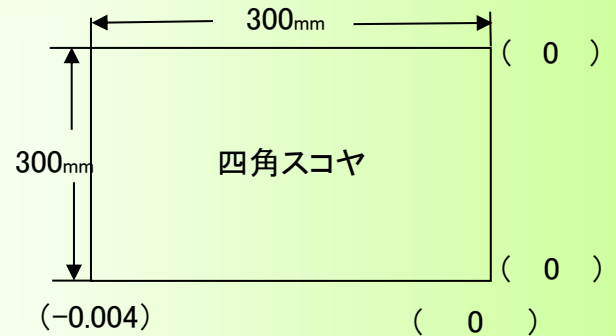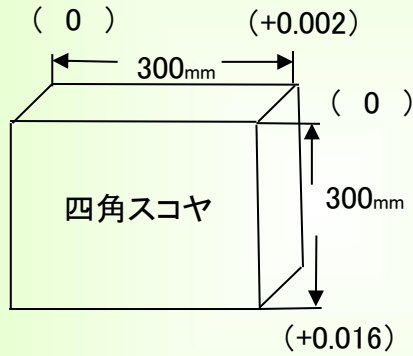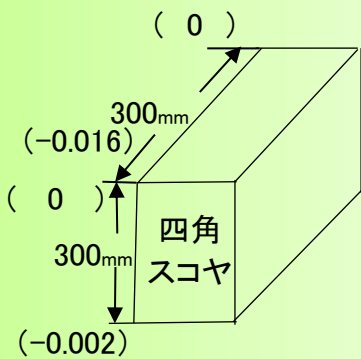

上面精度

テーブルサイズ: 500角

()パレット1
[]パレット3

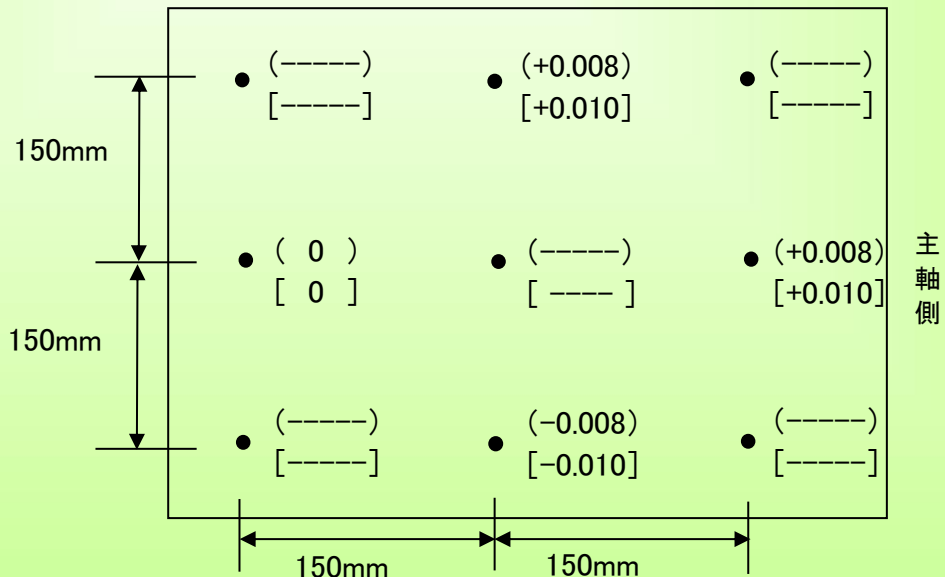

2023/11/21