


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	1989	管理番号	H017283
型式	MH-2V	測定者	山口	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

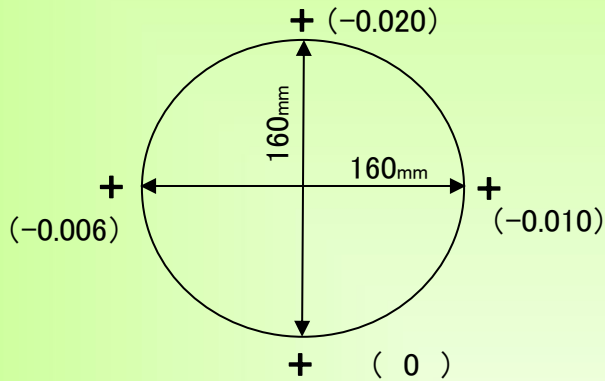

主軸振れ



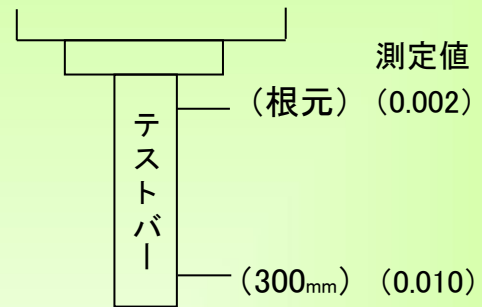


直角度

【YZ】測定値 (0.016)


【XZ】測定値 (0.006)

【XY】測定値 (0.004)

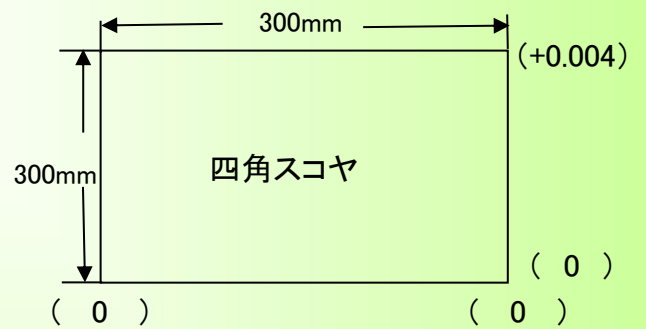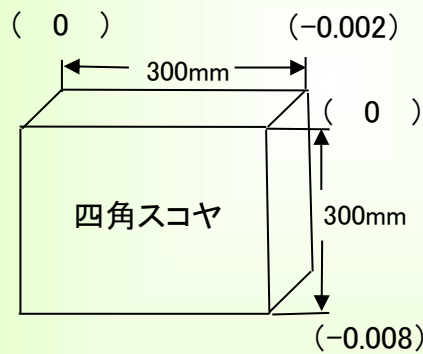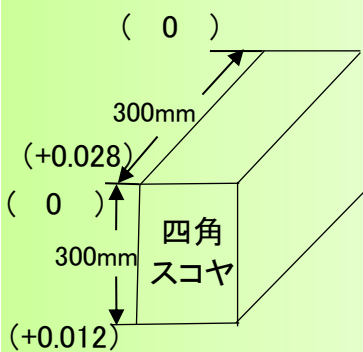

上面精度

※テーブルサイズ 1310×300

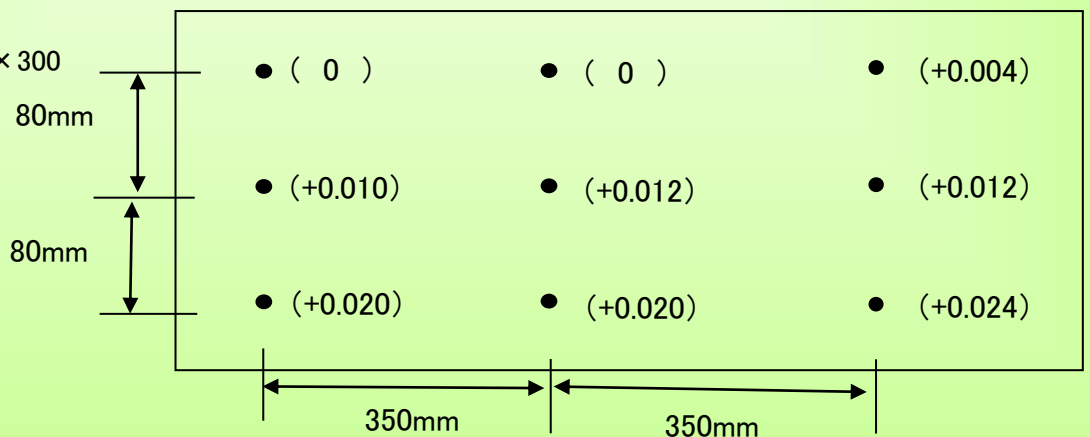

2023/8/10