


精度測定検査表


Examination for precision list

| | | | | | |
|------|--------|-----|------|--------|---------|
| メーカー | ブラザー | 年式 | 2007 | 管理番号 | P008353 |
| 型式 | TC-S2C | 測定者 | 金子 | アシスタント | |

振り回し(200ピッチ)



主軸振れ






直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.004)

【XY】測定値 (0.010)

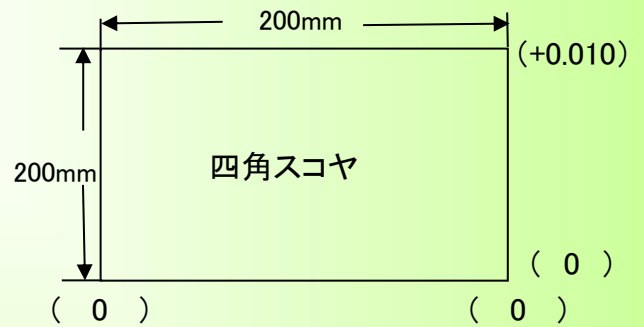

上面精度

※テーブルサイズ 600×320



2024/3/5