


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	滝沢	年式	1994	管理番号	P008514
型式	MC-V SUPER	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

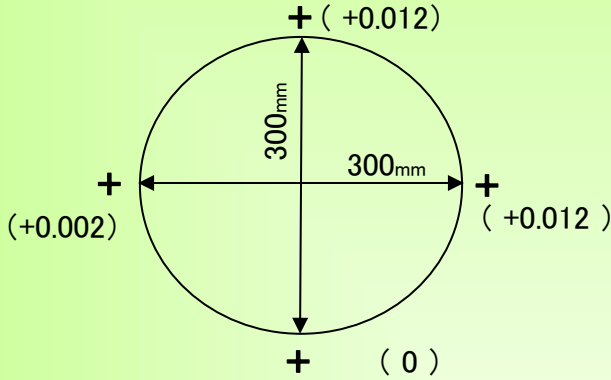

主軸振れ



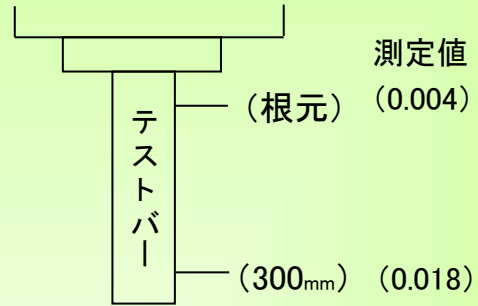


直角度

【YZ】測定値 (0.018)


【XZ】測定値 (0.012)

【XY】測定値 (0.002)

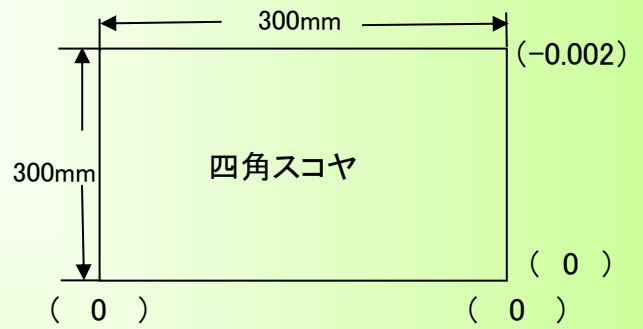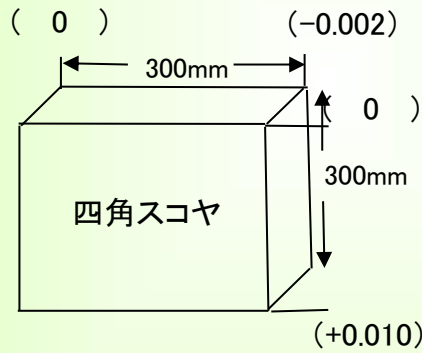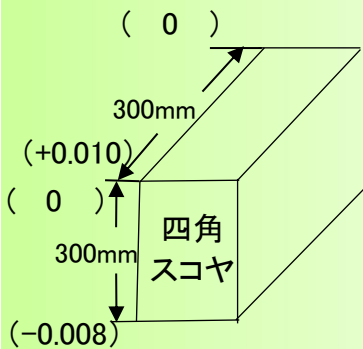

上面精度

※テーブルサイズ 900×410

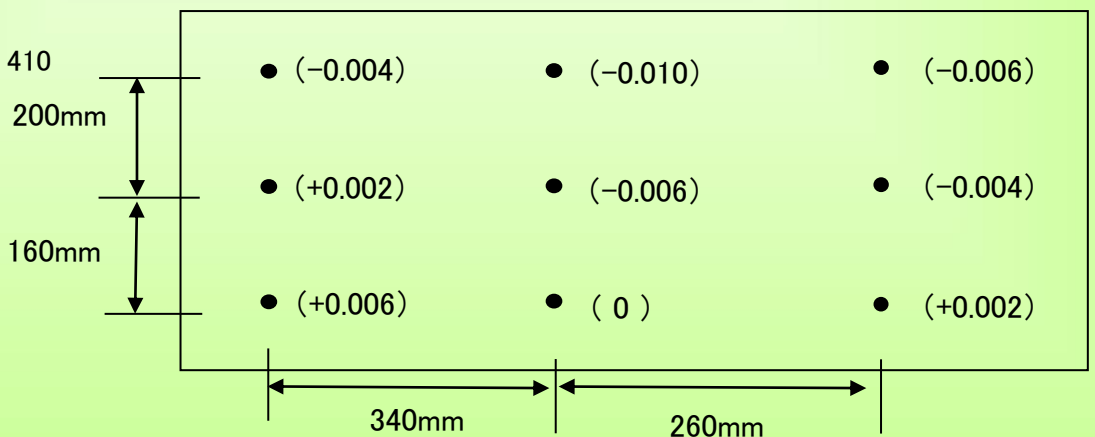

2024/4/26