# 精度測定検査表

*Examination for precision list*

| メーカー | 日立精機 | 年式 | 2001年製 | バーコード | P006628 |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | VS40 | 当社評価 | | 測定者 | 小林(博) |

## 振り回し(300ピッチ)

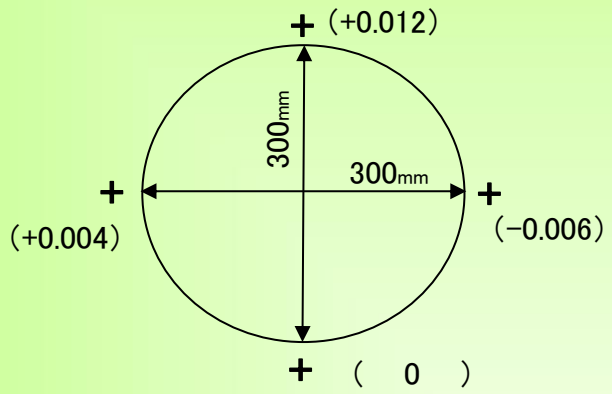


## 主軸振れ

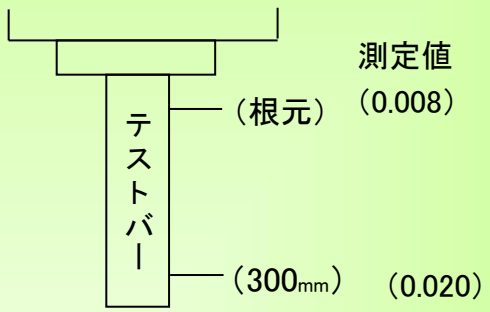


## 直角度

【YZ】測定値 (0.006)

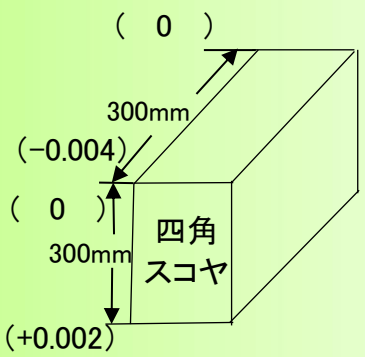


【XZ】測定値 (0.002)

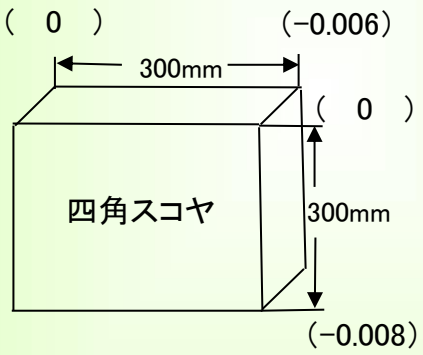


【X Y】測定値 (0.006)

## 上面精度
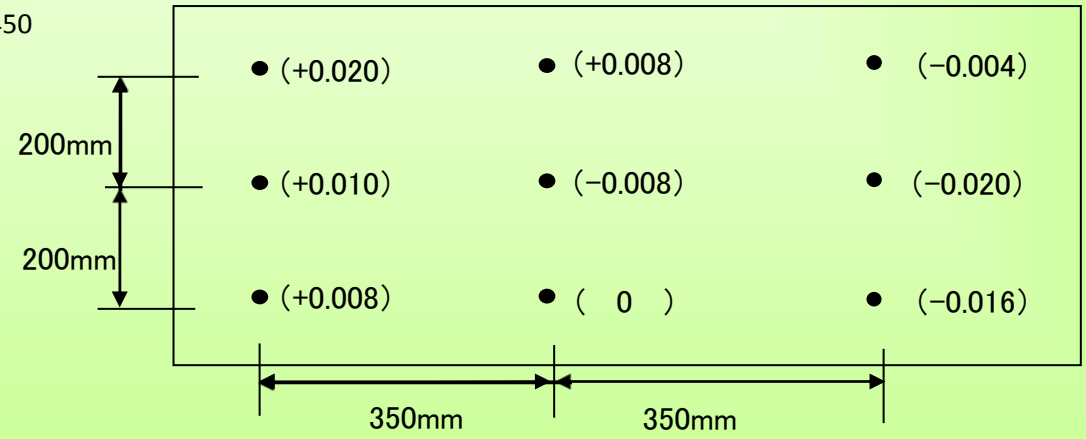
※テーブルサイズ 900×450