精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ヤマザキマザック	年式	1991年製	管理番号	P006691
型式	MTV-515	測定者	武藤	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

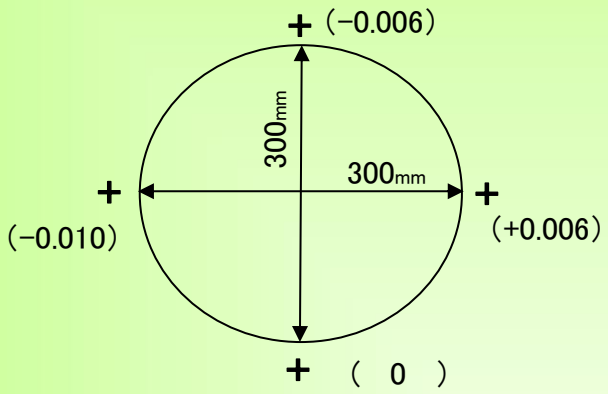

主軸振れ

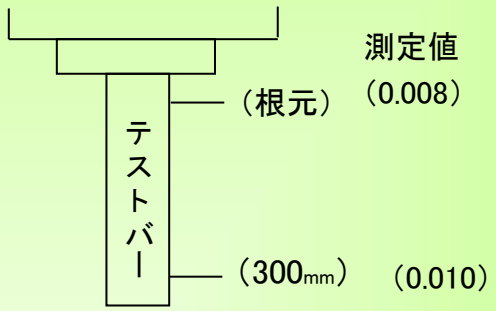

直角度

【Y Z】測定値 (0.012)

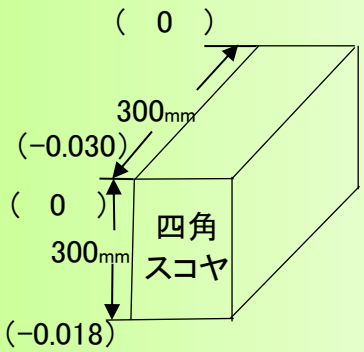

【X Z】測定値 (0.024)

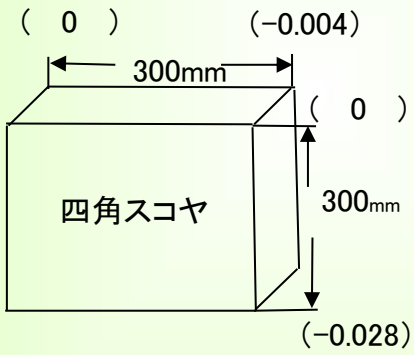

【X Y】測定値 (0.014)

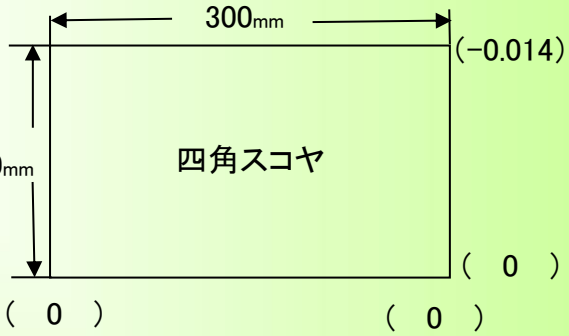

上面精度

※テーブルサイズ 1300×550

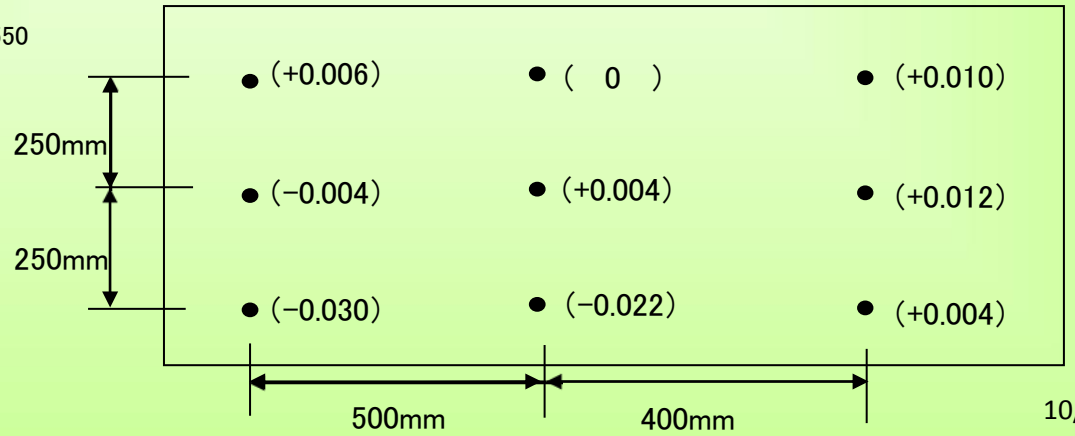

10/5