



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	1997年製	管理番号	P006822
型式	MCV-460	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


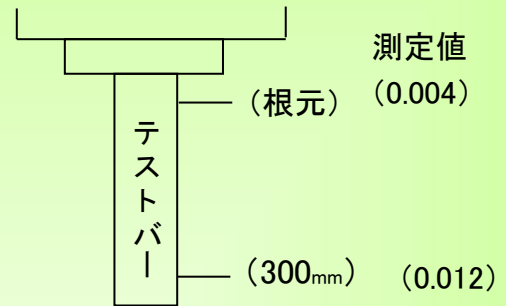
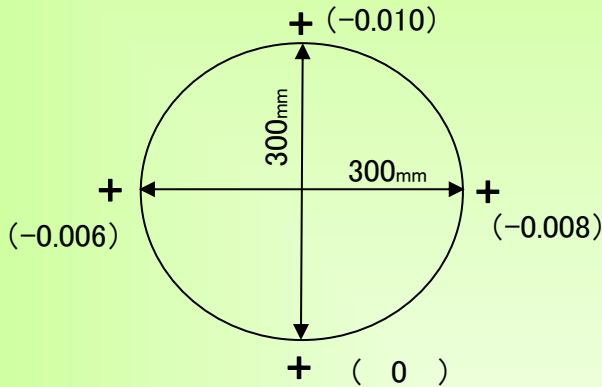


直角度

【Y Z】測定値 (0.016)

【X Z】測定値 (0.016)

【X Y】測定値 (0.008)

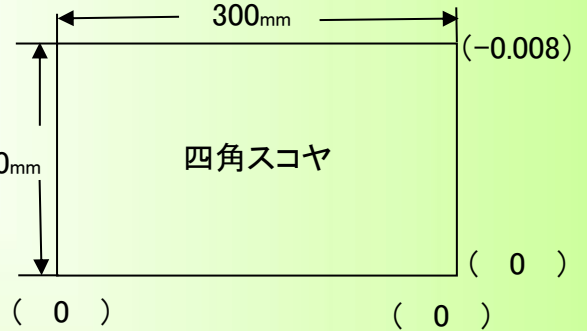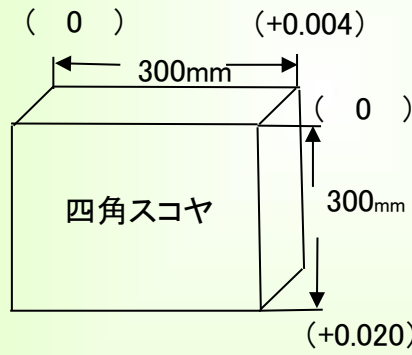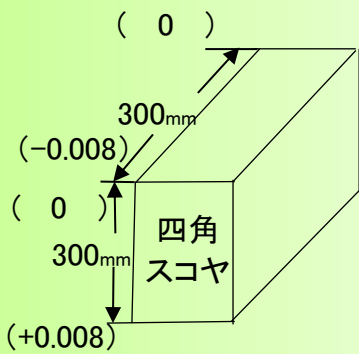

上面精度

※テーブルサイズ 1200×450

