



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2001年製	管理番号	P006808
型式	MILLAC-611V	測定者	金子	アシスタント	島田

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


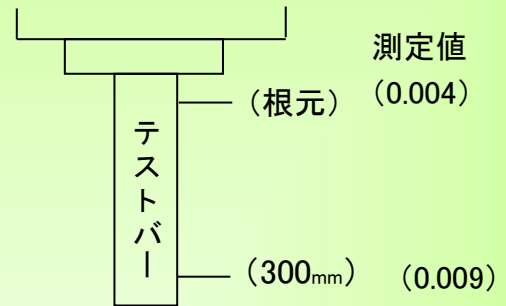
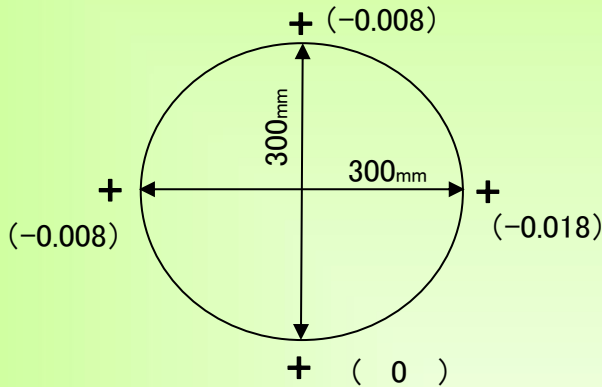


直角度

【Y Z】測定値 (0.008)

【X Z】測定値 (0.004)

【X Y】測定値 (0.004)

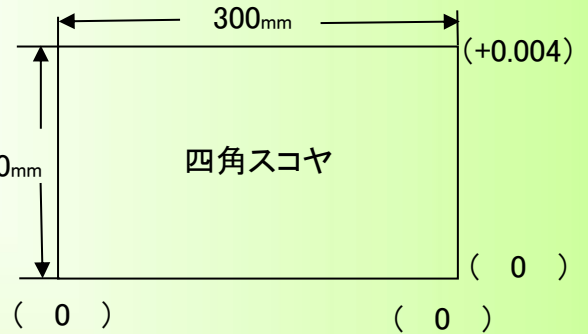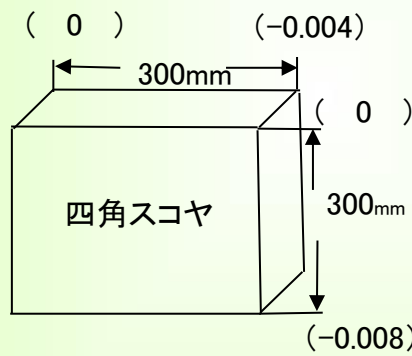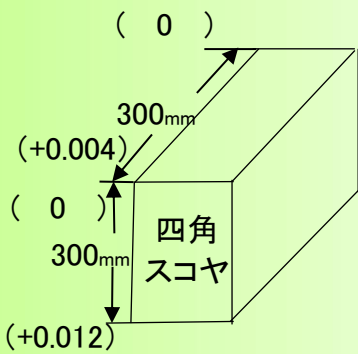

上面精度

※テーブルサイズ 1400×610

