



# 精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	日立精機	年式	2002年製	管理番号	P006688
型式	VS50	測定者	平野	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

## 主軸振れ


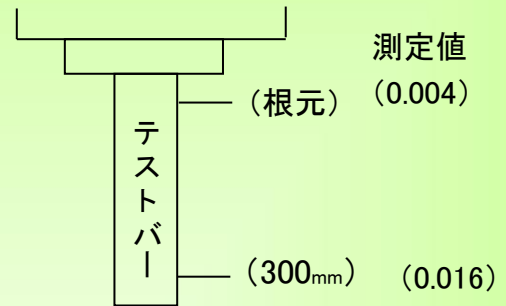
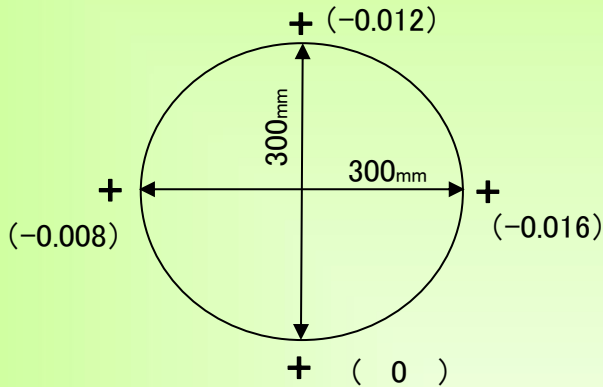


## 直角度

【Y Z】測定値 (0.008)

【X Z】測定値 (0.010)

【X Y】測定値 (0.010)

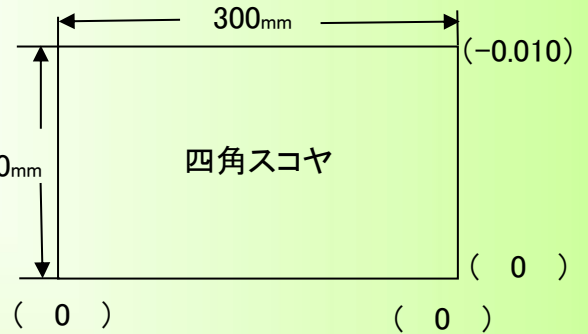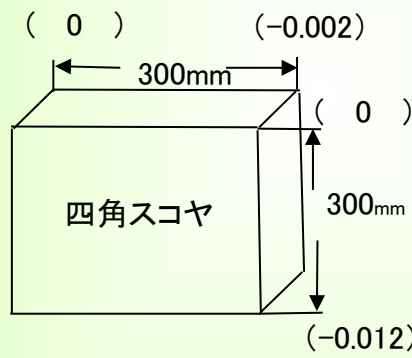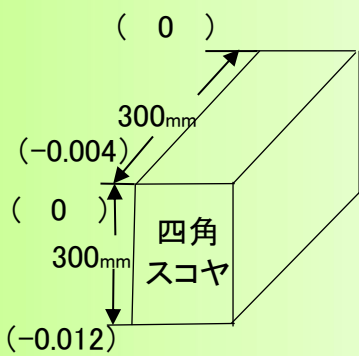

## 上面精度

※テーブルサイズ 1000×450

