精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2006年製	管理番号	P006853
型式	MB-46VAE	測定者	野辺沼	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

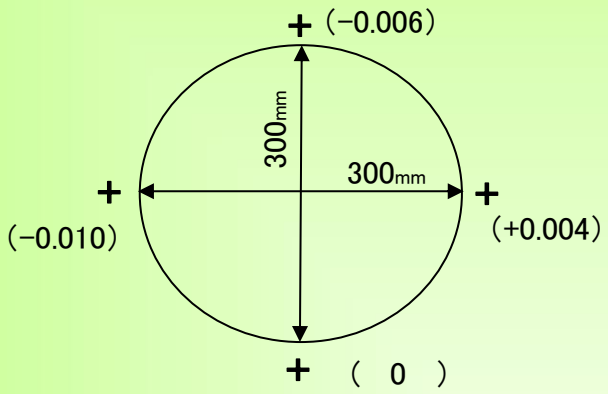

主軸振れ

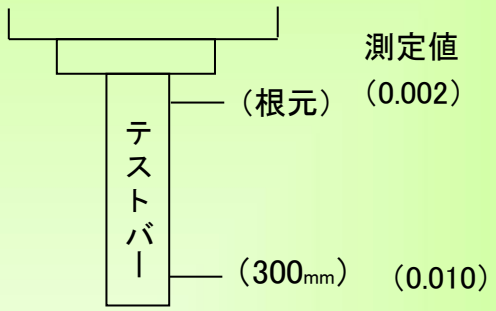

直角度

【Y Z】測定値 (0.018)

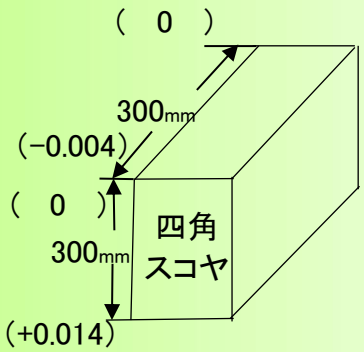

【X Z】測定値 (0.002)

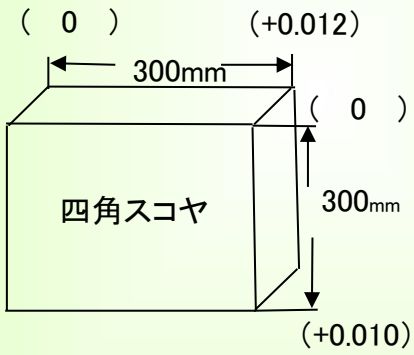

【X Y】測定値 (0.012)

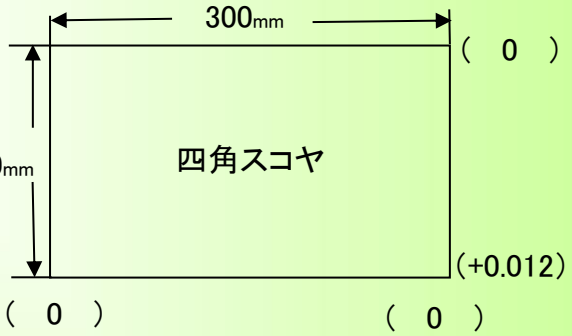

上面精度
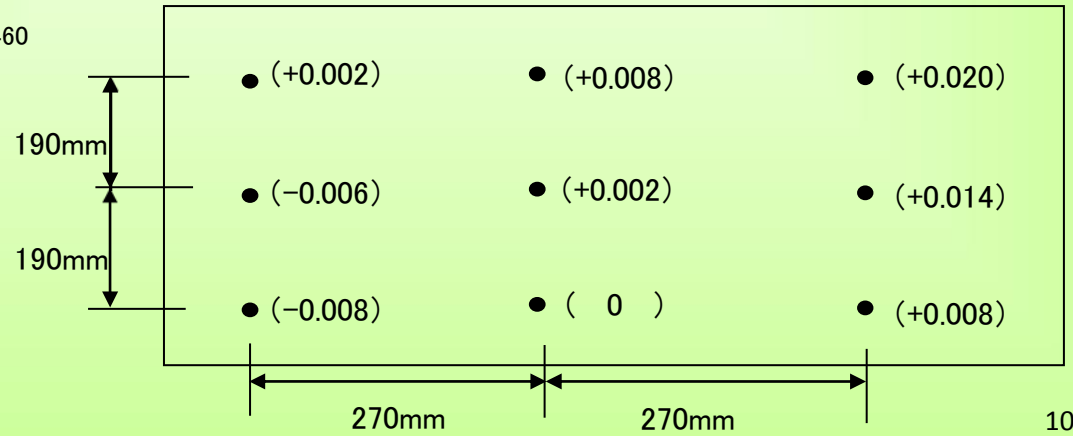
※テーブルサイズ 1000×460