



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2005年製	バーコード	P006935
型式	NV4000	測定者	金子	アシスタント	竜輝

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ


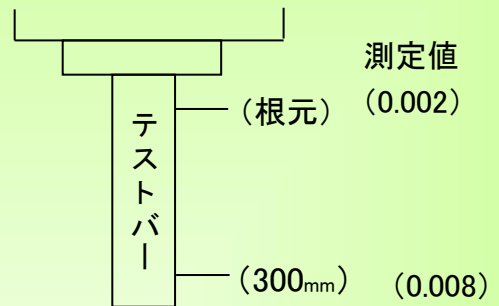
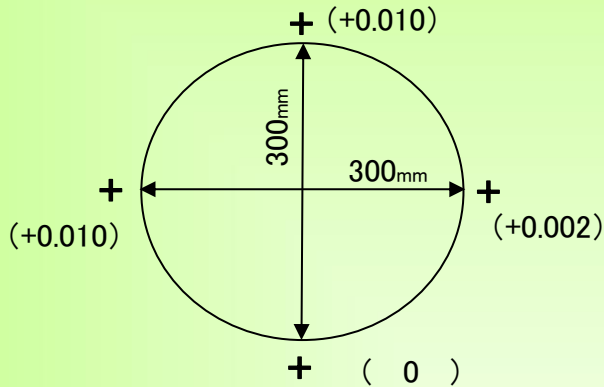


直角度

【YZ】測定値 (0.006)

【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.004)

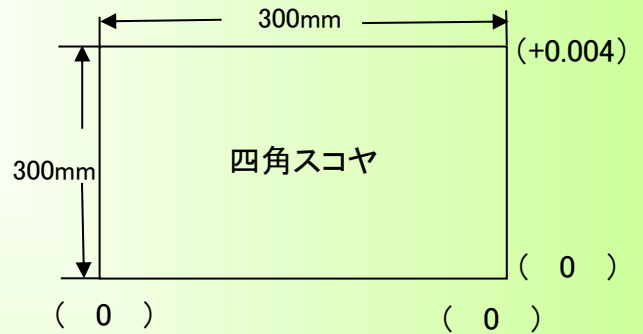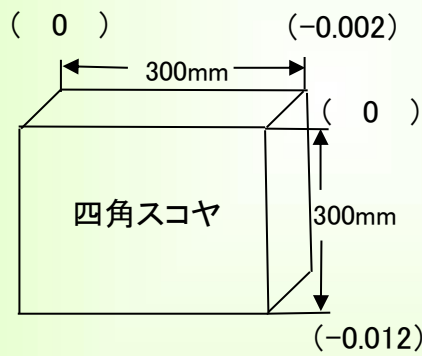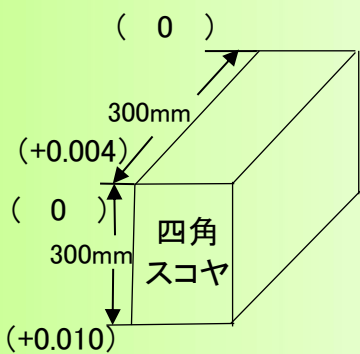

上面精度

※テーブルサイズ 700×450

