



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	オークマ	年式	2007年製	バーコード	H015136
型式	MILLAC-852V	測定者	平野	アシスタント	仙田

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

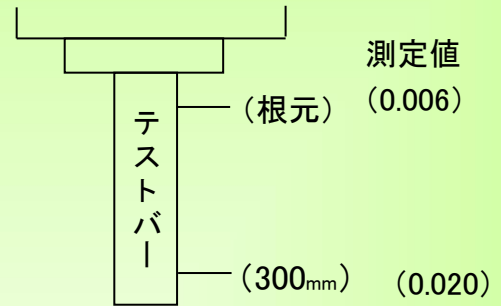
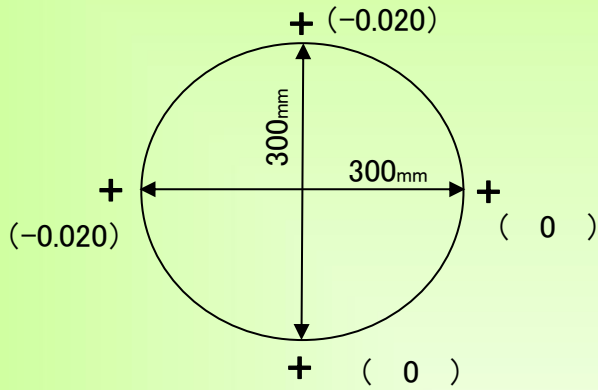


直角度

【YZ】測定値 (0.004)

【XZ】測定値 (0.010)

【XY】測定値 (0.006)

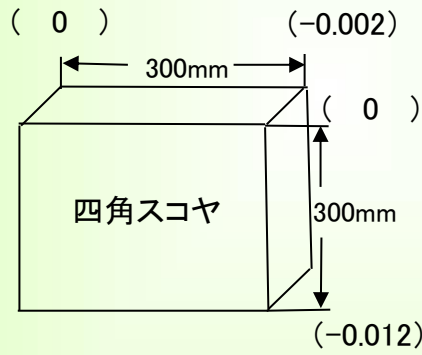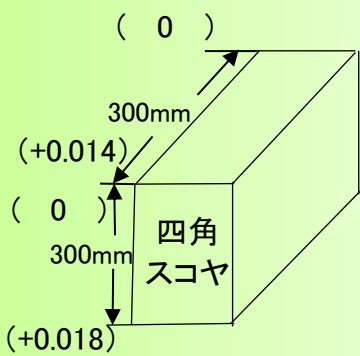

上面精度

※テーブルサイズ 2200×850

