



精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	OKK	年式	1993年製	バーコード	P006923
型式	MCV-410	測定者	金子	アシスタント	竜輝

振り回し(300ピッチ)

主軸振れ

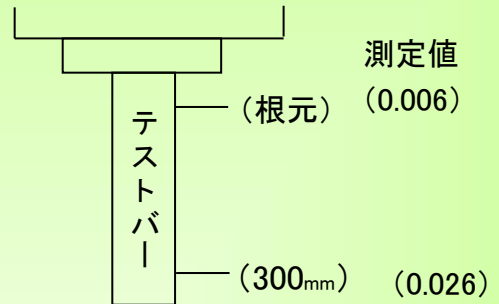
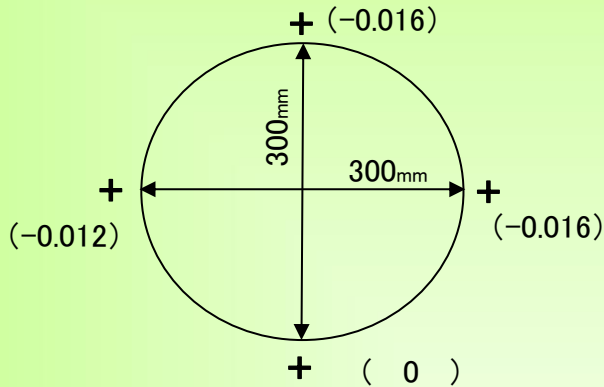


直角度

【YZ】測定値 (0.008)

【XZ】測定値 (0.018)

【XY】測定値 (0.008)

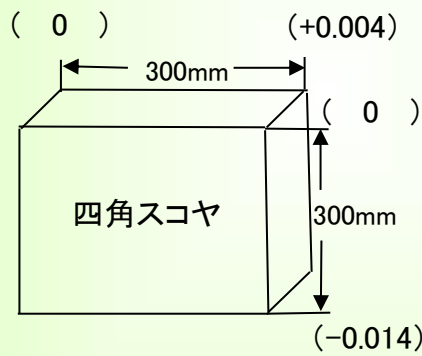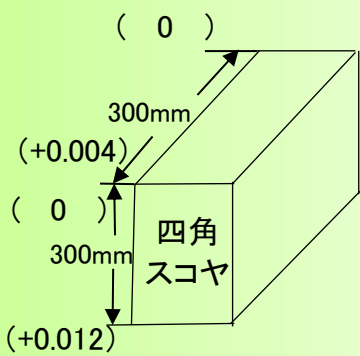

上面精度

※テーブルサイズ 1000×450

