精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2007年製	バーコード	P006908
型式	α-T21iES	測定者	金子	アシスタント	竜輝

振り回し(300ピッチ)

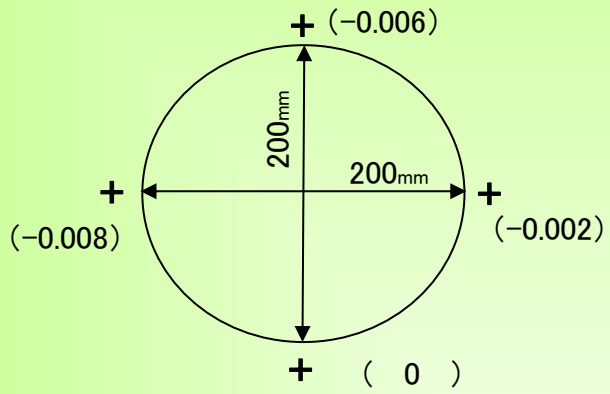

主軸振れ

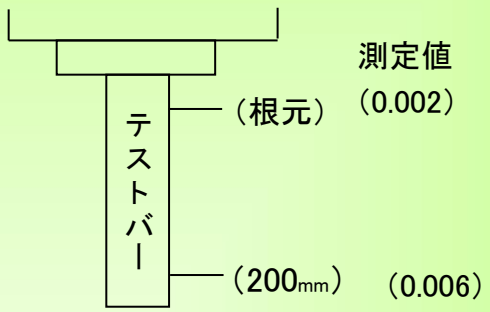

直角度

【YZ】測定値 (0.004)

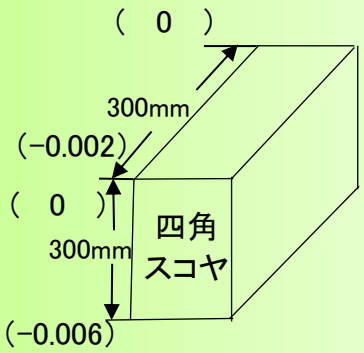

【XZ】測定値 (0.012)

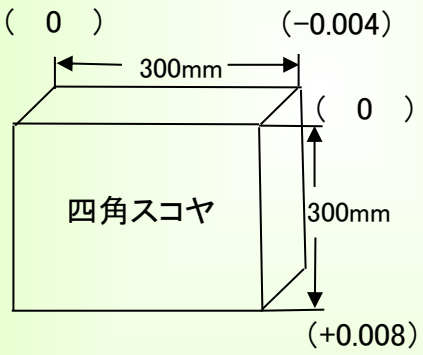

【X Y】測定値 (0.004)

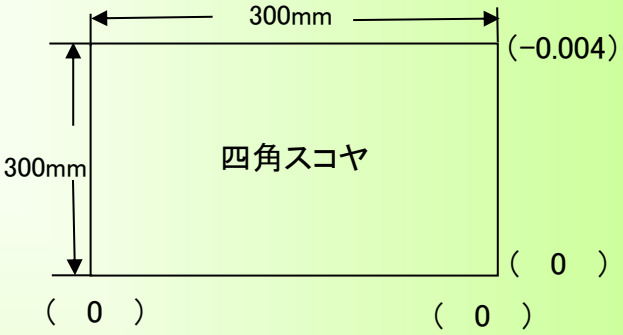

上面精度
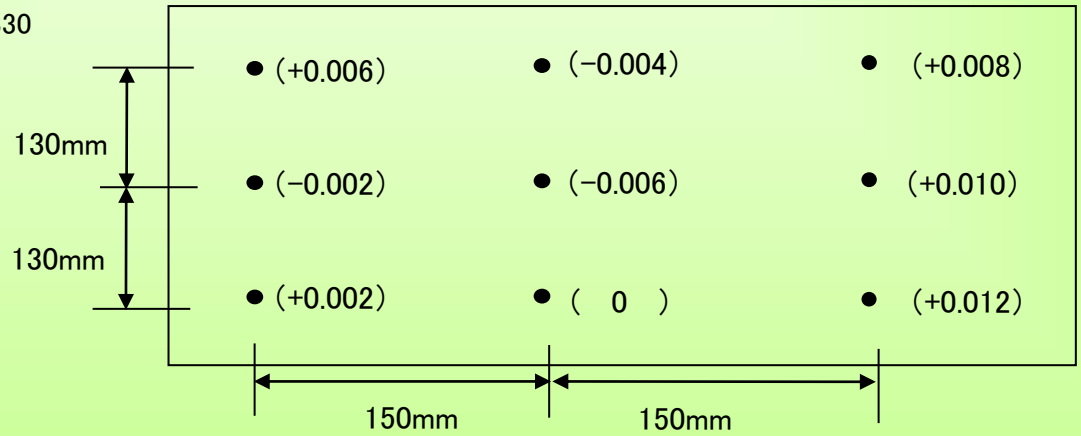
※テーブルサイズ 630×330