



# 精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	1997年製	バーコード	H015285
型式	FMR-40	測定者	仙田	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

## 主軸振れ


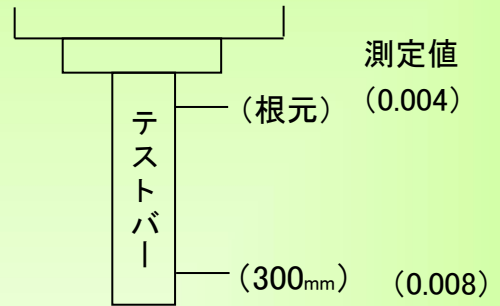
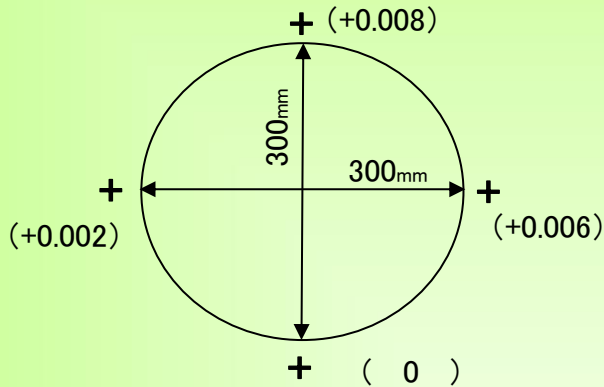


## 直角度

【YZ】測定値 (0.028)

【XZ】測定値 (0.020)

【XY】測定値 (0.006)

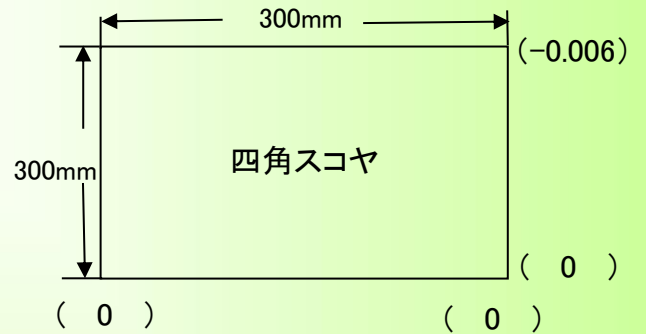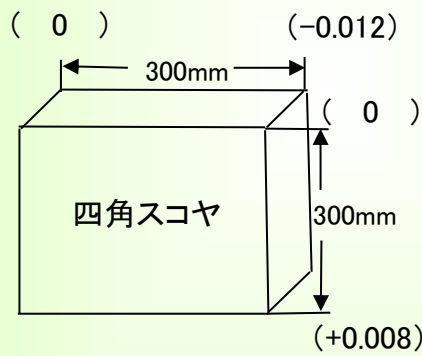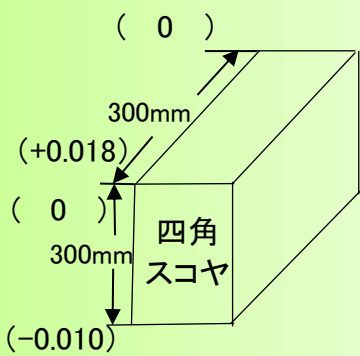

## 上面精度

※テーブルサイズ 800×410

