



# 精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	1999年製	バーコード	P006910
型式	MILLAC-611V	測定者	金子	アシスタント	

## 振り回し(300ピッチ)

## 主軸振れ


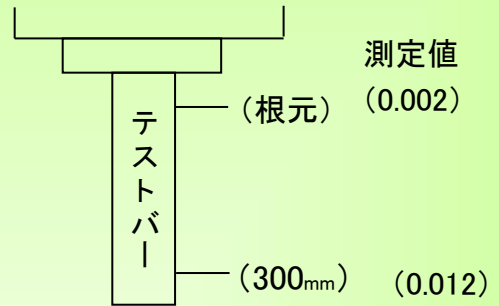
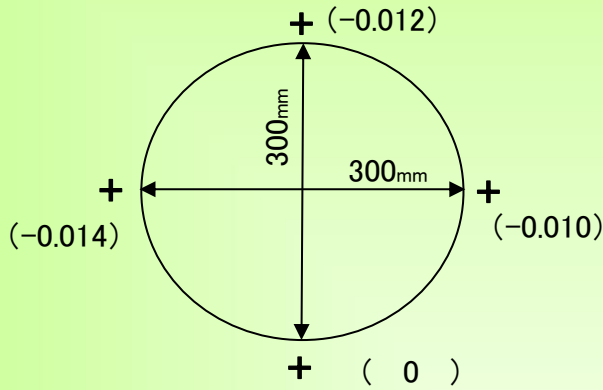


## 直角度

【YZ】測定値 (0.014)

【XZ】測定値 (0.018)

【XY】測定値 (0.014)

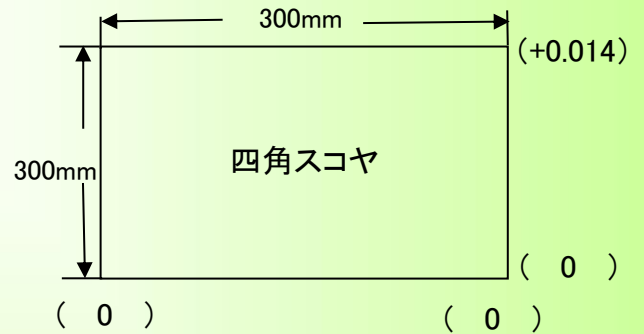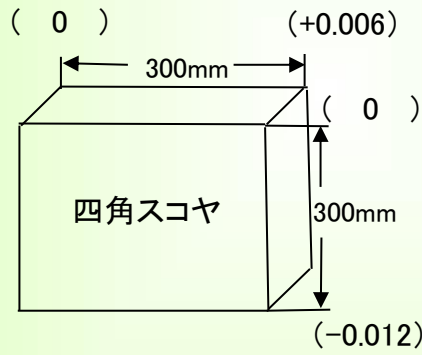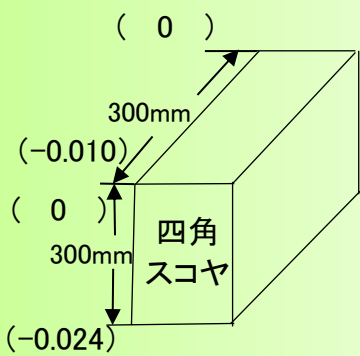

## 上面精度

※テーブルサイズ 1600×610

