


精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	森精機	管理番号	P007052		
型式	CL-200B	年式	1997年製	測定者	宮原


刃物台精度

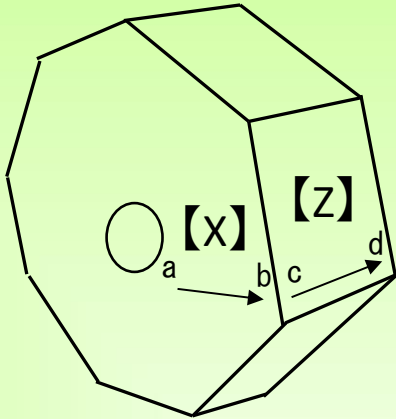

X軸 外レット番号3(a 0 → b -0.014)
外レット番号7(a 0 → b -0.010)
(移動量60mm)

Z軸 外レット番号3(c 0 → d -0.020)
外レット番号7(c 0 → d -0.010)
(移動量70mm)

主軸と刃物台の穴中心精度

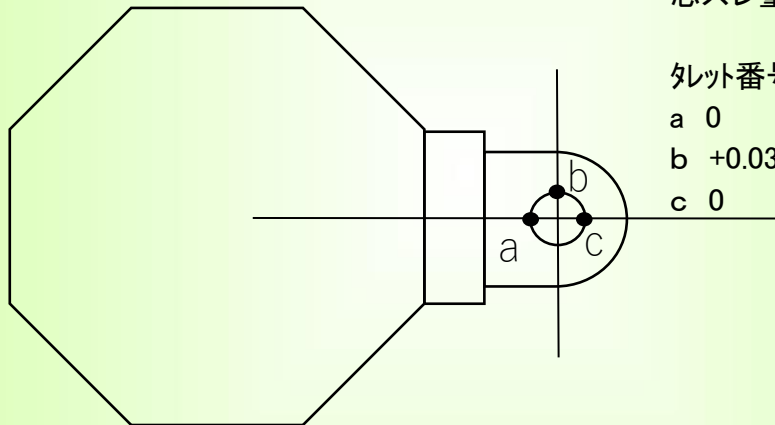

芯ズレ量

外レット番号7

a 0
b +0.030
c 0

テスト加工

