精度測定検査表

Examination for precision list

メーカー	大隈豊和	年式	2001年製	バーコード	P007121
型式	MILLAC-1052V	測定者	金子	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

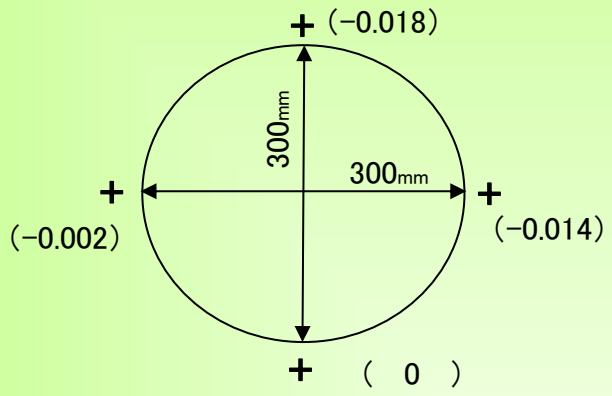

主軸振れ

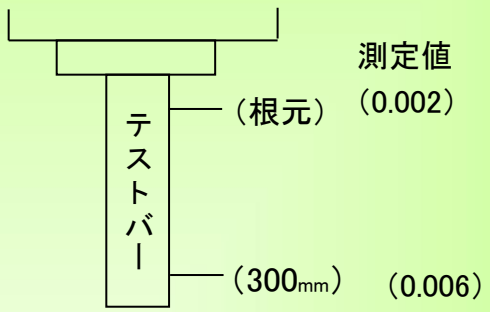

直角度

【YZ】測定値 (0.008)

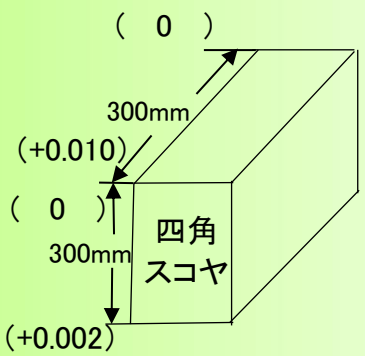

【XZ】測定値 (0.018)

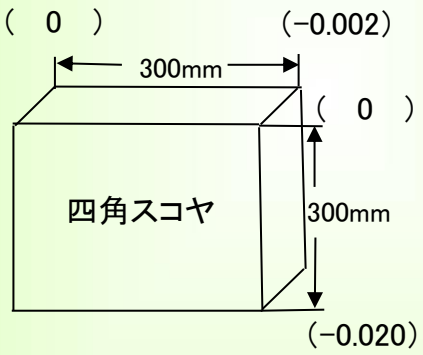

【X Y】測定値 (0.010)

上面精度
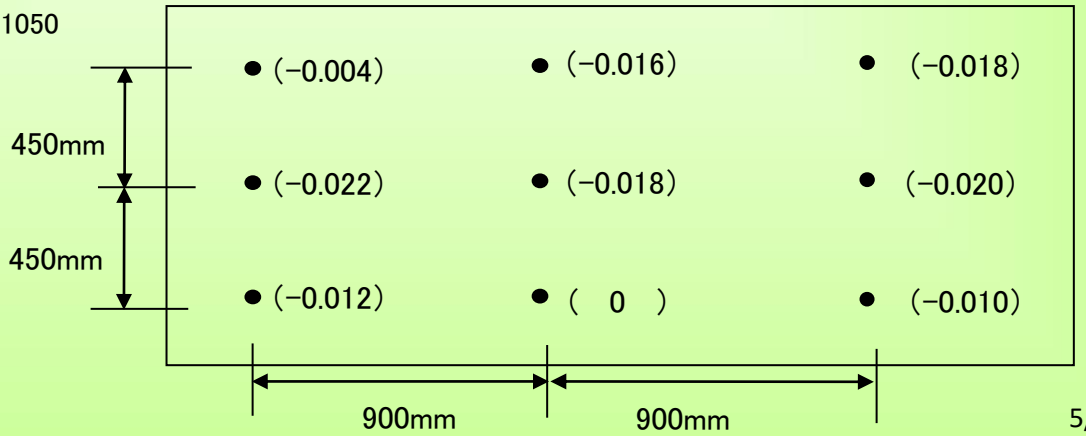
※テーブルサイズ 2200×1050