


精度測定検査表

Examination for precision list


精度評価		コメント
A	0 ~ 0.02mm	新品です。 気温7°Cで実施。
B	0 ~ 0.03mm	
C	0 ~ 0.04mm	
D	0 ~ 0.05mm	

メーカー	牧野フライス	バーコード	P4035
型式	a51C2		


Z軸方向の平行度

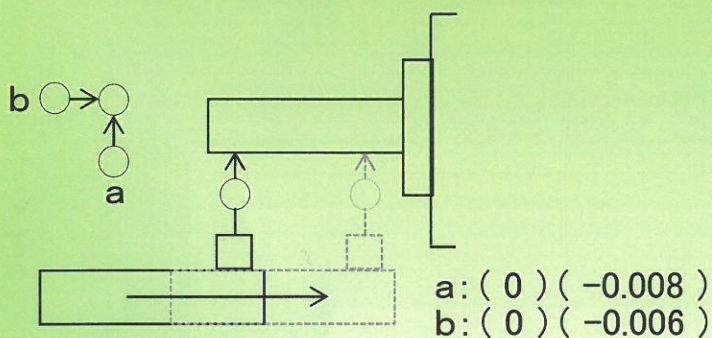

主軸振れ

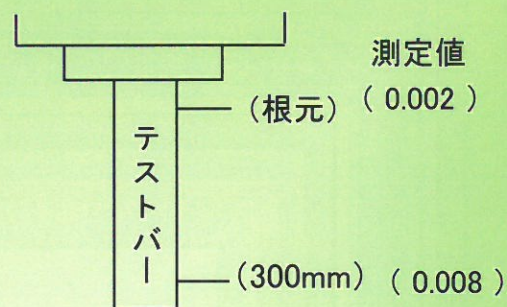

直角度

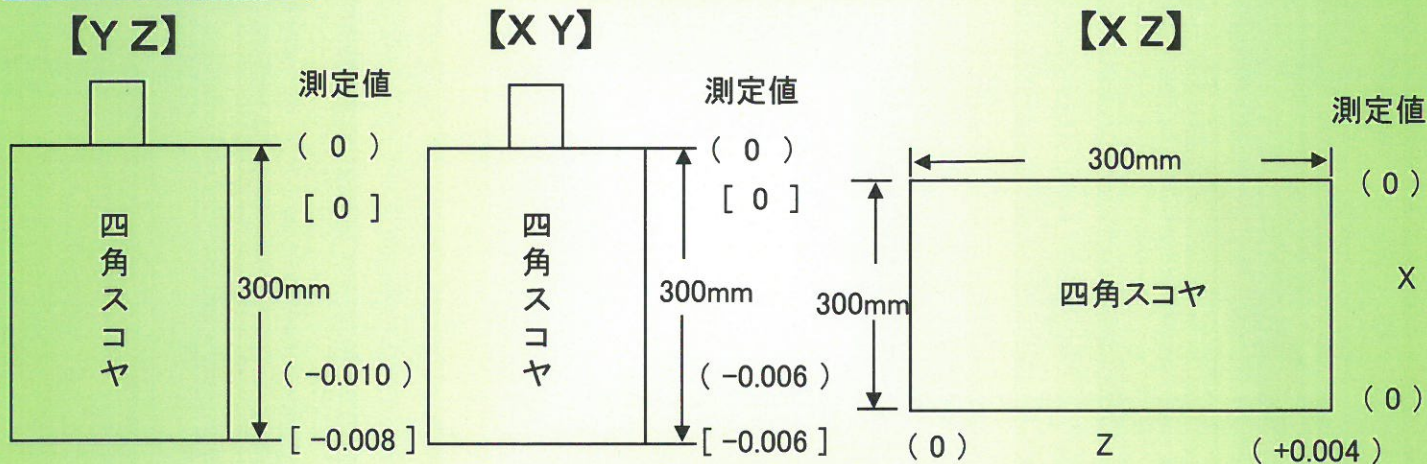

上面精度

