


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	森精機	年式	2004年製	管理番号	P005322
型式	ZV400/APC	測定者	奥沢	アシスタント	

振り回し(300ピッチ)

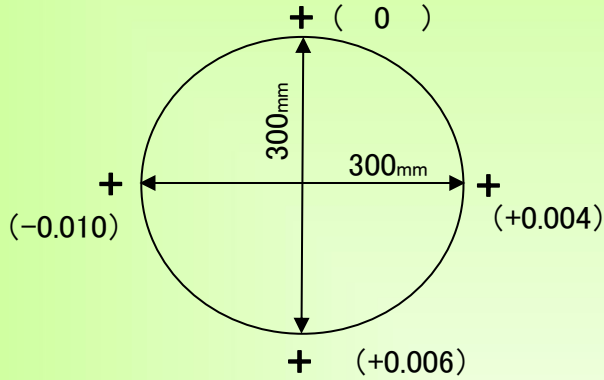

主軸振れ



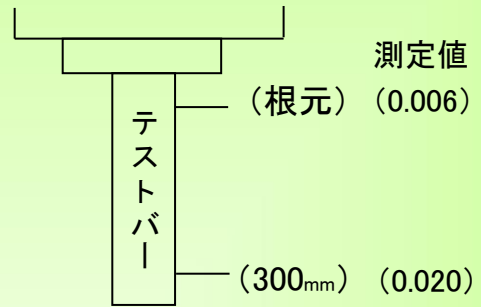


直角度

【YZ】測定値 (0.010)


【XZ】測定値 (0.002)

【XY】測定値 (0.010)

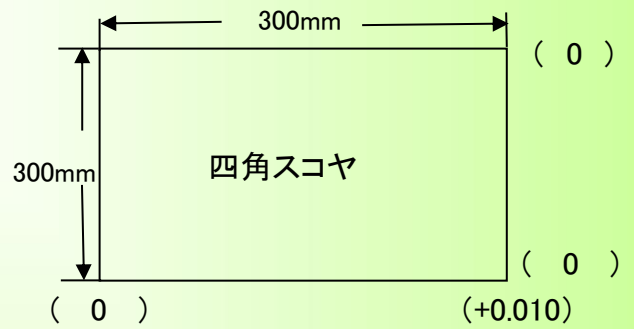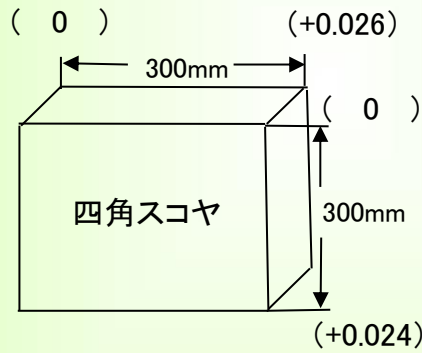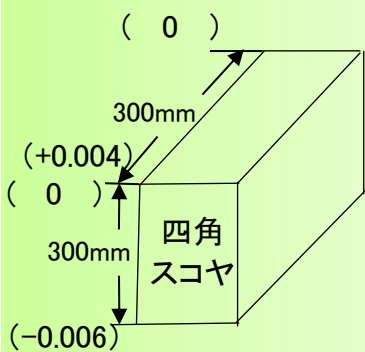

上面精度

※テーブルサイズ φ350

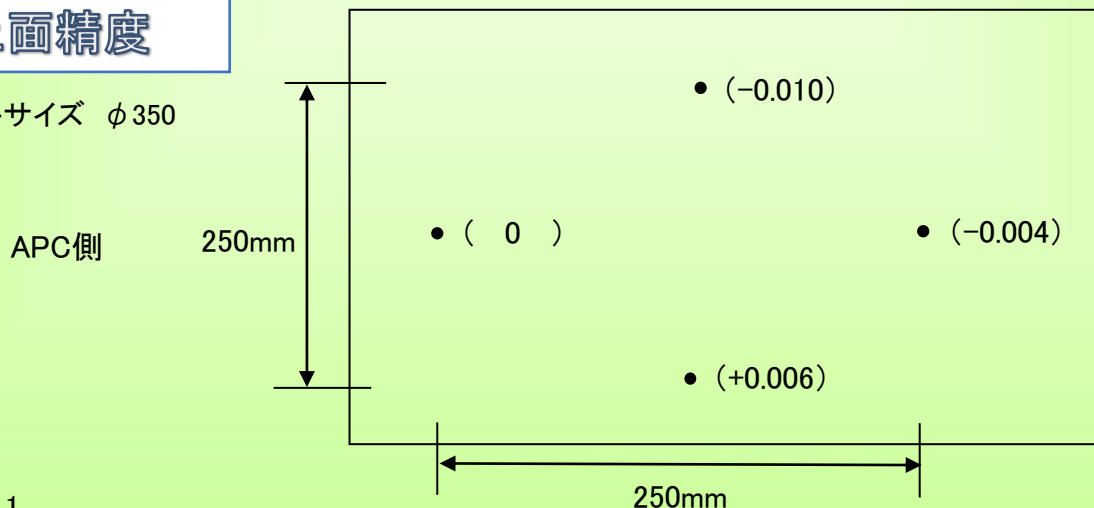

2021/11/11