


精度測定検査表


Examination for precision list

メーカー	ファナック	年式	2007年製	管理番号	P008135
型式	α -T21iES	測定者	金子(拓)	アシスタント	

振り回し(200ピッチ)

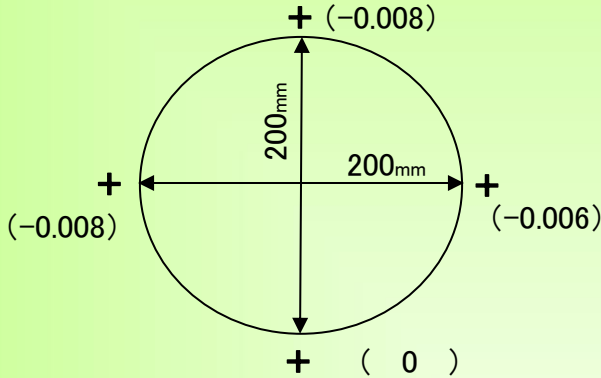

主軸振れ



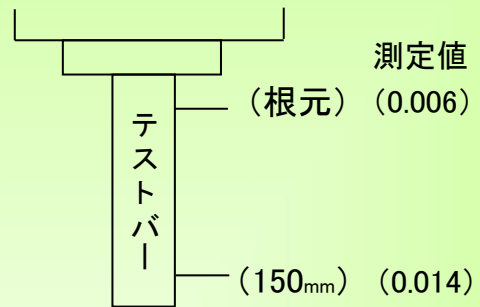


直角度

【YZ】測定値 (0.004)


【XZ】測定値 (0.016)

【XY】測定値 (0.002)

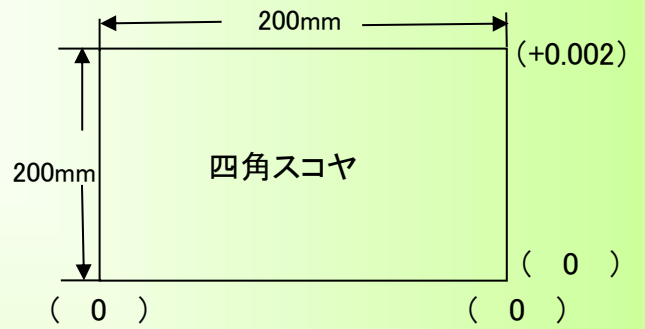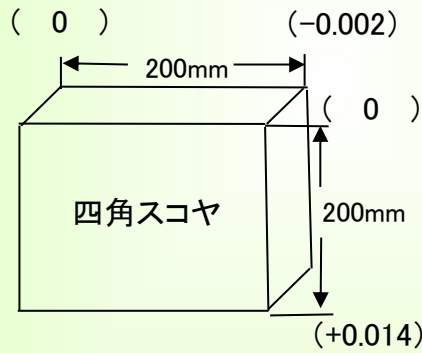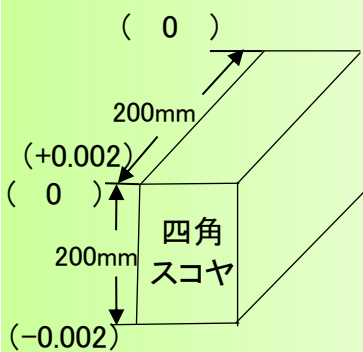

上面精度

※テーブルサイズ 630×330

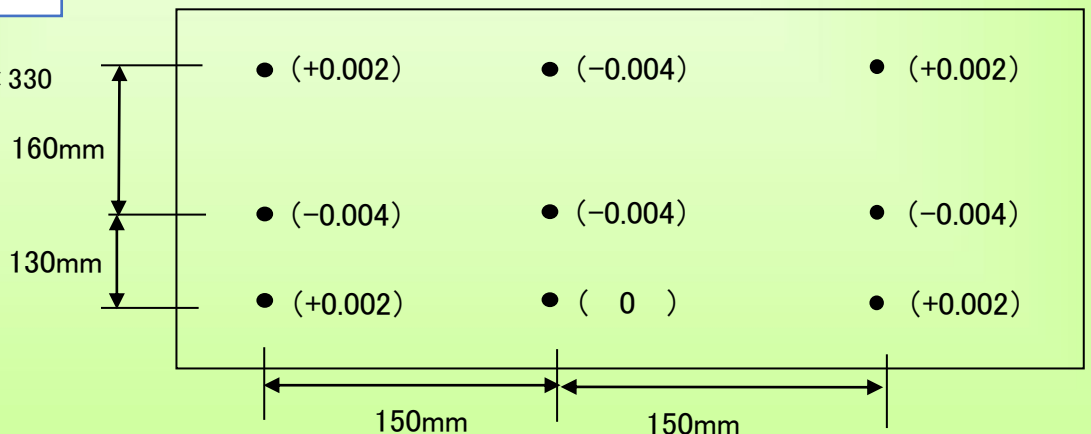

2023/1/25